


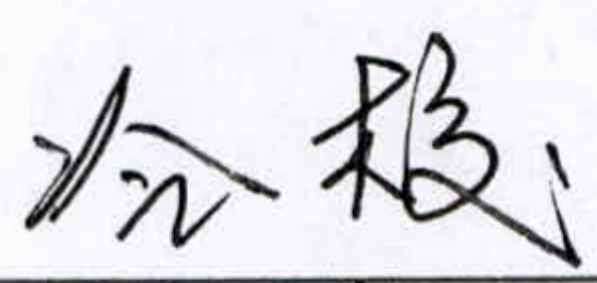


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：西安精准电子科技有限责任公司

编 号：0709-2021-2023

审核组长（签字）：

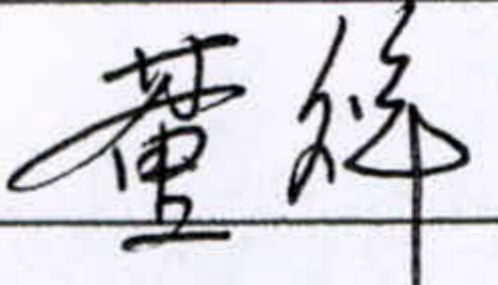审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 8 月 22 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	西安精准电子科技有限责任公司	企业联系人	王胜利
认证证书编号	ISC-2021-1069	证书有效期	2026-07-19 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年08月22日
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 董祥 2022-M1MMS-1295594	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、质量部、采 供部、研发部、生产 部（仪表、电控车间）

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2022 年 7 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 6 月 10-6 月 11 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 6 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 6 月 15 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 6 月 26 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理总经理雷雨主持，管理者王胜利汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 4 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度无新增关键测量过程：对原有关键测量过程持续控制情况：

a) 计量要求的导出和验证：查《1.0 级旋进旋涡流量计示值误差校准》测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定: 查《1.0 级旋进旋涡流量计示值误差校准》测量过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查《1.0 级旋进旋涡流量计示值误差校准》测量过程, 采用比对方法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查《1.0 级旋进旋涡流量计示值误差校准》测量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查《1.0 级旋进旋涡流量计示值误差校准》测量过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源: 公司未建立最高标准, 企业测量设备全部外送西安航天计量测试研究所、陕西省计量科学研究院、西安西自仪检测技术有限公司、国防科技工业 6113 二级计量站、深圳华科计量检测技术有限公司和广东省科学院电子电器研究所等单位校准/检定。抽查 8 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要能源为电和水, 每月电耗、水耗, 由园区物业公司收取费用, 2022 年全年用电量: 58700kwh; 水 481 吨。折算为 7.26 吨/标煤。不属于重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

企业 2022 年度测量管理体系监督审核未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年没有顾客的投诉。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了 4 项质量目标, 质量部对目标进行了分解, 查 2022 年 7 月到 2023 年 7 月质量目标完成情况检查表, 每月按目标、措施、完成情况分别进行了统计, 记录内容全, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构均未发生变化。产品没有增加, 测量管理体系覆盖范围无变化。

9. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:



公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。公司对标志的使用，符合相关标准和规定的要求。

10. 本次监督审核未严重不符合项，发现 1 个次要不符合项。

抽查生产部编号 200116 直流电阻箱的计量确认记录，最后一次检定日期：记录为 2023 年 5 月 51 日，出现笔误；记录的确认时间为：2023 年 6 月 15 日，早于检定日期 2023 年 7 月 5 日。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.4 条计量确认过程记录的要求。

11. 法制计量情况：

现场检查，企业是计量器具生产单位，共有 8 份计量器具型式批准证书和 19 份产品防爆证书，均在有效期内，符合要求。强检压力表已实现定点定周期检定。基本符合要求。

查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 8 月 22 日，对西安精准电子科技有限公司的现场监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程连续受控。本年度无新增关键测量过程。对原有关键测量过程按控制规范的要求实施了连续的控制、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控。测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为西安精准电子科技有限公司的测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

其它说明事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、董祥