



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	丽水市新时代教育印刷有限公司	陪同人员	项宗林
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:

查空压设备的储气罐上在用的的压力表和安全阀, 未提供检定和检验报告。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款

☒GB/T 50430-2017 标准 条款:

☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☒GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款

☐能源认证标准:

条款

☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 林兵, 华丹儿

审核组长: 林兵

受审核方代表: 项宗林

日期: 2022-2-19

日期: 2022-2-19

日期: 2022-2-19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

基本有效。

审核员: 林兵

日期: 2022-3-15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

空压设备的储气罐上在用的的压力表和安全阀, 未提供检定和检验报告。

纠正情况:

已按照法律法规及标准条款的要求, 于 2022 年 2 月送至第三方检测中心进行检定。

原因分析:

2021 年 12 月份新购入空压设备, 对于检验要求法律意见不强, 对压力表和安全阀管理失位。

纠正措施:

公司严格执行管理体系及法律法规的要求, 公司要求质检部加强体系文件及法律法规的学习, 提高质量意识, 并再购一个新压力表, 并按 6 个月周期抽换使用, 让压力表及安全阀在受控状态下使用。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

公司内检查可能使用压力表和安全阀的情况, 除空压房储气罐使用外, 无其他使用。

受审核方纠正措施有效性的验证:

基本有效。

验证人:

日期: 2022-3-15

受审核方代表:

日期: 2022-3-15



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督（一）次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	丽水市新时代教育印刷有限公司	陪同人员	项宗林
受审核部门	设计部	预计整改 完成日期	
不符合事实描述： 查设计部检验用电子天平检定证书、数显千分测厚规、钢直尺的计量器具，提供的检定/校准证书已超过一年期。 上述事实不符合：☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐GB/T 50430-2017 标准 条款： ☒GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☒GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：林兵，华丹儿 审核组长：林兵 受审核方代表：陈小平 日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19 日 期： 2022-2-19			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 基本有效。 审核员：林兵 日期： 2022-3-			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

设计部检验用电子天平检定证书、数显千分测厚规、钢直尺的计量器具,提供的检定/校准证书已超过一年期。

纠正情况:

计量器具已按照法律法规及标准条款的要求,于 2022 年 1 月 20 日送至第三方计量校准机构进行校准/检定。

原因分析:

设计部质量管理意识未能真正的落到实处,从而导致“漏检”现象的产生。

纠正措施:

设计部经理立即做好计量器具的第三方校准/检定工作,同时,为了使质检部全体员工严格执行管理体系及法律法规的要求,公司要求质检部加强体系文件及法律法规的学习,提高质量意识。

预定完成日期: 2022-3-15

举一反三检查情况:

设计部经理检查其余计量器具检定情况,查有无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

基本有效。

验证人: 邵小平 日期: 2022-3-15

受审核方代表: 邵小平 日期: 2022-3-15



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L1247

中国航发南方工业有限公司计量实验室

Meteorology Lab of AECC South Industry Co., Ltd.

(国防科技工业 4311 二级计量站)

校准证书

Certificate of Calibration

证书编号 Cer. No: LFS-HFJL22KS02280146

委托物品 Entrusted Sample	带刻度放大镜
型号/规格 Type/Model	GP2010-100K
制造商 Manu	昆山高品精密仪器有限公司
编号 NO	2102487/JC-FDJ-01
委托方 Customer	丽水市新时代教育印刷有限公司
地址 Addr	浙江丽水市水阁工业园区清波路 6 号
接收日期 Rec.Date	2022 年 02 月 28 日
校准日期 Cal. Date	2022 年 02 月 28 日

签发人:

Issued by



实验室地址: 湖南省株洲市董家墩
邮 编: 412002
邮 政 信 箱: 株洲市 211 信箱计量所
电话: 0731-28572008
传真: 0731-28572008

Addr: Dongjiaduan, Zhuzhou, Hunan
Zip Code: 412002
P.O.B: Metrology Institute of P.O.B.211,zhuzhou
Tel:0731-28572008
Fax:0731-28572008

中国航发南方工业有限公司计量实验室

证书编号 Cer.No: LFS-HFJL22KS02280146

说明

Description

- 1、本实验室是中国合格评定国家认可委认可的校准/检测实验室，认可证书号为：L1247
The lab is a calibration/detecting lab authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment, the authorization certificate No. is L1247
- 2、本实验室是国防法定计量技术机构，许可证编号：XK 国防 JLJG-2-032
The lab is legal metrology of national defence technology organization, the license certificate No. is XK National defence, JLJG-2-032
- 3、测量结果可溯源到国家计量基准

This measurement results is traceable to National Standard of Measurement.

校准用标准 Cal.STD Used

计量标准名称 STD Name	型号/规格 Type	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy	编号 No	证书号 Cer.No	有效期 Valid Date To
玻璃线纹尺	(0~1) mm	/	ZZ0066	210544259	2022 年 06 月 11 日
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

校准依据文件 Refer Document

JJG 571-2004《读数、测量显微镜检定规程》

环境条件 Env.Condition

温度 Temp	22 °C	空气湿度 Air humid	59 %RH
校准地点 Calibration Addr: 现场	其它 Other: /		

注：下次送校请带证书复印件

本结果仅对所校样品有效，证书未经本实验室批准，不准部分复制

These results apply only to the calibrated. The certificates must not be partially duplicated without permission from the Laboratory at which the calibration/verification has been conducted.

中国航发南方工业有限公司计量实验室

证书编号 Cer. No: LFS-HFJL22KS02280146

校准结果

Calibration Results

一、外观及工作正常性检查：符合要求

二、放大倍数校准

物镜标称放大倍数	物镜实测放大倍数	物镜放大倍数精确度	技术指标	结论
Nominal magnification	Actual magnification	Magnification accuracy	Specification	Conclusion
(X)	(X)	(%)	(%)	(P/F)
100	99.9	-0.1	±5	P

三、示值误差

	标准值(mm)	示值(mm)	误差(mm)
100X	0.10	0.10	0.00
	0.50	0.50	0.00
	1.00	1.00	0.00

结论：所校项目符合技术要求。

说明：测量结果的扩展不确定度 $U=8\%$, $k=2$

(依据 JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示)

建议下次校准日期：2023 年 02 月 27 日

以下空白

校准人 Cal.by:

龙星

审核人 Checked by:

王欣

丽水市质量检验检测研究院
丽水市计量技术研究院

检 定 证 书

证书编号: FAD2022020025 号

送 检 单 位 丽水市新时代教育印刷有限公司
使 用 单 位 丽水市新时代教育印刷有限公司
计 量 器 具 名 称 电子天平
型 号 / 规 格 JA1003
出 厂 编 号 2100902
制 造 单 位 广州玉治仪器有限公司
检 定 依 据 JJG 1036-2008《电子天平》
检 定 结 论 合格



批准人 陈新

核验员 刘凯

检定员 刘倩

检定日期 2022 年 2 月 28 日

有效期至 2023 年 2 月 27 日



证书真伪查询

计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2018)33010号 电话(Tel): 0578-2661088

地址: 丽水市中山街北395号

邮编(PostCode): 323000

传真(Fax): 0578-2133735

<http://www.lsjyjc.com:81/jl>

检定证书编号: FAD2022020025	第 1 页 共 1 页
-----------------------	-------------

1、本次检定所用计量标准:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
天平检定装置	1mg~40kg	F ₁ 等级、E ₂ 等级 (Max=500g)	[2017]浙量标丽证 字第670号	2026年1月19日

2、本次检定所用主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	证书编号	有效期至
E ₂ 等级砝码	1mg~500g	E ₂ 等级	LSmm2021-10766	2022. 03. 18

3、检定地点、环境条件:

地点: 本院

温度: 22℃

湿度: 59%RH

4、被检定计量器具的准确度等级: Ⅱ级

5、检定结果:

d= 0.001g		e= 0.01g	Max= 100g
检定项目		检定结果 (g)	最大允许误差 (g)
天平偏载误差		-0.002	±0.005
天平重复性		0.003	0.010
天平示 值误差	0g ≤m≤ 50g	0.000	±0.005
	50g <m≤ 100g	-0.002	±0.010
	/ <m≤ /	/	/



【以下空白】

注:未经本院书面批准,不得部分复制此证书。

本院检测能力查询: <http://www.lsjyjc.com/newshow?id=3776>

丽水市质量检验检测研究院
丽水市计量技术研究院

检 定 证 书

证书编号: LAH2022020020 号

送 检 单 位 丽水市新时代教育印刷有限公司
使 用 单 位 丽水市新时代教育印刷有限公司
计 量 器 具 名 称 钢直尺
型 号 / 规 格 (0~500) mm
出 厂 编 号 /
制 造 单 位 得力集团有限公司
检 定 依 据 JJG1-1999《钢直尺》
检 定 结 论 合格



批准人 叶战峰

核验员 陈丽

检定员 杨颖

检定日期 2022 年 2 月 28 日

有效期至 2023 年 2 月 27 日



证书真伪查询

计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2018)33010号 电话(Tel): 0578-2661088

地址: 丽水市中山街北395号

邮编(PostCode): 323000

传真(Fax): 0578-2133735

<http://www.lsjyjc.com:81/jl>

检定证书编号: LAH2022020020	第 1 页 共 1 页
-----------------------	-------------

1、本次检定所用计量标准:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
三等金属线纹尺标准 装置	(0~1000) mm	三等	[2007]浙量标丽证 字第013号	2022年12月5日

2、本次检定所用主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	证书编号	有效期至
三等标准金属线纹尺	(0~1) m	三等	GD-20210300289	2022. 03. 09

3、检定地点、环境条件:

地点: 精测室

温度: 20°C

湿度: 62%RH

4、被检定计量器具的最大允许误差: $\pm 0.15\text{mm}$

5、检定结果:


合格。

【以下空白】



注:未经本院书面批准,不得部分复制此证书。

本院检测能力查询: <http://www.jsjyjc.com/newshow?id=3776>

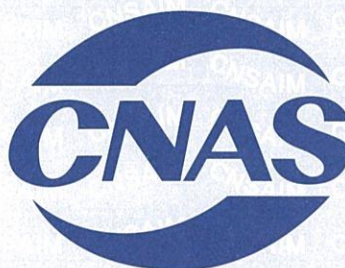

中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L1247

中国航发南方工业有限公司计量实验室

Meteorology Lab of AECC South Industry Co.,Ltd.

(国防科技工业 4311 二级计量站)

校准证书

Certificate of Calibration

证书编号 Cer. No: LFS-HFJL22KS02280145

委托物品 Entrusted Sample	三用紫外分析仪
型号/规格 Type/Model	ZF-1S
制造商 Manu	杭州齐威仪器有限公司
编号 NO	C3821021705/JC-ZW-01
委托方 Customer	丽水市新时代教育印刷有限公司
地址 Addr	浙江丽水市水阁工业园区清波路6号
接收日期 Rec.Date	2022年02月28日
校准日期 Cal. Date	2022年02月28日

签发人:

Issued by

吴端

签发单位(专用章)

Cal Center Stamp

实验室地址: 湖南省株洲市董家墩
邮编: 412002
邮政信箱: 株洲市 211 信箱计量所
电话: 0731-28572008
传真: 0731-28572008

Addr: Dongjiaduan, Zhuzhou, Hunan
Zip Code: 412002
P.O.B: Metrology Institute of P.O.B.211,zhuzhou
Tel:0731-28572008
Fax:0731-28572008

中国航发南方工业有限公司计量实验室

证书编号 Cer.No: LFS-HFJL22KS02280145

说明

Description

- 1、本实验室是中国合格评定国家认可委认可的校准/检测实验室，认可证书号为：L1247
The lab is a calibration/detecting lab authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment, the authorization certificate No. is L1247
- 2、本实验室是国防法定计量技术机构，许可证编号：XK 国防 JLJG-2-032
The lab is legal metrology of national defence technology organization, the license certificate No. is XK National defence, JLJG-2-032
- 3、测量结果可溯源到国家计量基准
This measurement results is traceable to National Standard of Measurement.

校准用标准 Cal.STD Used

计量标准名称 STD Name	型号/规格 Type	不确定度/准确度 Uncertainty/Accuracy	编号 No	证书号 Cer.No	有效期 Valid Date To
标准紫外辐射照度计	UIT-250	/	ZZ5079	216082765	2022年06月25日
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

校准依据文件 Refer Document

JJF(闽)1095-2020《紫外分析仪校准规范》

环境条件 Env.Condition

温度 Temp	22 °C	空气湿度 Air humid	59 %RH
校准地点 Calibration Addr: 现场	其它 Other: /		

注：下次送校请带证书复印件

本结果仅对所校样品有效，证书未经本实验室批准，不准部分复制
These results apply only to the calibrated. The certificates must not be partially duplicated without permission from the Laboratory at which the calibration/verification has been conducted.

中国航发南方工业有限公司计量实验室

证书编号 Cer. No: LFS-HFJL22KS02280145

校准结果

Calibration Results

一、外观及工作正常性检查：符合要求

二、辐照度示值

波长	紫外辐照度
Wavelength	Ultraviolet Irradiance
(nm)	($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
254	18.0
365	20.1

结论：所校项目符合技术要求。

说明：测量结果的扩展不确定度 $U=16\%$, $k=2$

(依据 JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示)

建议下次校准日期：2023 年 02 月 27 日

以下空白

校准人 Cal.by:

刘峰

审核人 Checked by:

张

丽水市质量检验检测研究院
丽水市计量技术研究院

校 准 证 书

证书编号: LA02022020003 号

委 托 方 丽水市新时代教育印刷有限公司
使 用 单 位 丽水市新时代教育印刷有限公司
测 量 器 具 名 称 数显千分测厚规
型 号 / 规 格 (0-10)mm
准 确 度 等 级 最小分度值: 0.001mm
制 造 单 位 温州三和量具仪器有限公司
出 厂 编 号 20Y1011
校 准 依 据 JJF1255-2010《厚度表校准规范》



批准人 叶战峰
核验员 杨颖
校准员 陈阳

校准日期 2022 年 3 月 1 日



证书真伪查询

计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2018)33010号 电话(Tel): 0578-2661088

地址: 丽水市中山街北395号

邮编(PostCode): 323000

传真(Fax): 0578-2133735

<http://www.lsjyjc.com:81/jl>

(建标)校准证书编号: LA02022020003	第 1 页 共 1 页
---------------------------	-------------

1、法定计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2018)33010号

2、本次校准所用计量标准:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
指示量具检定装置	(0~50) mm	MPE: (1~6) μ m	[2014]浙量标丽证 字第369号	2022年3月6日

3、本次校准所用主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	证书编号	有效期至
量块	(0.5-100) mm 83块	4等	GD-20210400319	2022. 04. 15

4、校准地点、环境条件:

地点: 长度室2

温度: 20°C

湿度: 57%RH

5、校准结果:

一、外观:符合

二、示值误差校准结果

校准点标称值 (mm)	校准点实测值 (mm)
0.5	0.501
1	1.002
2	2.001
3	3.001
4	3.997
5	4.998
6	5.996
7	7.001
8	8.002
9	9.001
10	10.002

三、示值变动性: <0.005mm

根据LZB100/2016测量不确定度评定报告本次校准结果的不
确定度: $U=5 \mu$ m $k=2$

【以下空白】

注:未经本院书面批准,不得部分复制此证书。

本院检测能力查询: <http://www.lsjyjc.com/newshow?id=3776>



丽水市质量检验检测研究院
丽水市计量技术研究院

检 定 证 书

证书编号: FAL2022020463 号

送 检 单 位 丽水市新时代教育印刷有限公司
使 用 单 位 丽水市新时代教育印刷有限公司
计 量 器 具 名 称 压力表
型 号 / 规 格 (0~1.6) MPa
出 厂 编 号 20210581021
制 造 单 位 杭州鹤山仪表有限公司
检 定 依 据 JJG 49-2013《弹性元件式精密压力表和真空表》
检 定 结 论 符合1.6级



批准人 叶战峰

核验员 杨颖

检定员 王群

检定日期 2022 年 3 月 1 日

有效期至 2022 年 8 月 31 日



证书真伪查询

计量检定机构授权证书号: (浙)法计(2018)33010号 电话(Tel): 0578-2661088

地址: 丽水市中山街北395号

邮编(PostCode): 323000

传真(Fax): 0578-2133735

<http://www.lsjyjc.com:81/jl>

检定证书编号: FAL2022020463	第 1 页 共 1 页
-----------------------	-------------

1、本次检定所用计量标准:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	计量标准证书编号	有效期至
精密压力表标准装置	(-0.1~60) MPa	0.4级	【2004】丽量标丽 证字第011号	2026年1月28日

2、本次检定所用主要计量标准器:

名称	测量范围	不确定度/准确度等级 /最大允许误差	证书编号	有效期至
精密压力表	(0~1.6) MPa	0.4级	FAK2021080001	2022.08.02

3、检定地点、环境条件:

地点: 压力室

温度: 22℃

湿度: 60%RH

4、被检定计量器具的准确度等级: 1.6级

5、检定结果:

检定项目	检定结果	最大允许误差/上限
外观	合格	/
零位误差	合格	/
指针偏转平稳性	合格	/
示值误差	0.01 MPa	±0.0256MPa
回程误差	0.01 MPa	0.0256MPa
轻敲位移	0.00 MPa	0.0128MPa



结论: 符合1.6级

【以下空白】


注: 未经本院书面批准, 不得部分复制此证书。

本院检测能力查询: <http://www.lsjyjc.com/newshow?id=3776>



安全阀校验报告

报告编号： AX2201212

使用单位	丽水市新时代教育印刷有限公司		
单位地址	水阁工业区清波路6号		
联系人	唐俊乾	联系电话	18057866052
用于设备	管道	工作介质	空气
安全阀类型	弹簧式	制造单位	浙江富羽阀门制造有限公司
安全阀型号	A28W-16T	公称通径	20 mm
工作压力	0.80 MPa	出厂编号	83588
要求整定压力	0.82 MPa	整定压力	0.82 MPa
密封试验压力	0.74 MPa	校验介质	氮气
校验方式	送校	执行标准	安全阀安全技术监察规程TS G ZF001-2006
校验结果：合格			
说明： ☒ 拆卸 ☒ 除锈 ☒ 铅封 ☒ 清理 ☐ /			
校验日期	2022年03月09日	下次校验日期	2023年03月
校验： 	日期：2022年03月09日	机构核准证号：TS7410067-2024  （机构检验专用章） 安全阀校验专用章 2022年03月11日	
审核： 	日期：2022年03月10日		
签发： 	日期：2022年03月11日		

备注：为保证安全阀在有效期内使用，请提前联系落实校验工作！

注 意 事 项

- 1、本报告书为依据《安全阀安全技术监察规程》对安全阀进行校验的结论报告。
- 2、本报告书应当由计算机打印输出，或用钢笔、签字笔填写，字迹要工整，涂改无效。
- 3、本报告书无检验、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
- 4、本报告书一式二份，由检验机构和使用单位分别保存。
- 5、受检单位对本报告结论如有异议，应在收到报告书之日起15日内，向检验机构提出书面意见。

单位地址：丽水市中山街北395号

邮政编码：323000

联系电话：0578—2661133 0578-2661135

