

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 22UA016890003

第 1 页共 3 页

Page of

客 户 名 称 : 四川正翔建筑装饰工程有限公司

Name of Customer

客 户 地 址 : 四川省德阳市珠江西路28号学生公寓3楼

Address of Customer

计 量 器 具 名 称 : 电子秤

Name of Instrument

规 格 / 型 号 : 5000g/0.01g

Type/Specification

制 造 单 位 : /

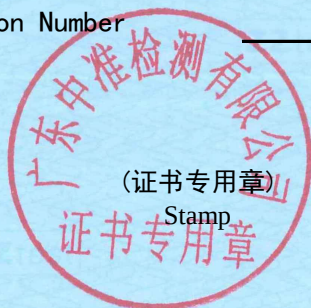
Manufacturer

出 厂 编 号 : /

Serial No.

管 理 编 号 : ZXJZ-04

Regulation Number

批准人
Approved by

赵广辉

职 务

工程师

Post

核 验 员

魏宇成

Checked by

校 准 员

许光

Calibrated by

委 托 日 期 2022 年 06 月 25 日

Received Date Year Mon Day

校 准 日 期 2022 年 06 月 28 日

Calibration Date Year Mon Day

签 发 日 期 2022 年 06 月 29 日

Issue Date Year Mon Day

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室

Add: Xili Shahe Road No.5298, Baiwong R&D Centre, Building 1,

11F, room 1110, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编 (Post): 518057

电话 (Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真 (Fax): 0755-26544550

网址 (Web): http://www.zztest.com.cn



校准说明

Directions of Calibration

证书编号： 22UA016890003
Certificate NO.

第 2 页 共 3 页
Page of

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关，带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with "*" is beyond the scope of our laboratory accreditation

2. 本次校准的技术依据：

Reference documents for the calibration:

参照JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具信息：

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差 或准确度等级 Uncertainty of Measurement or Maximum Permissible Errors	设备编号 Certificate No.	证书号/溯源单位 certificate No/Traceality to	有效日期 Due Date
砝码(100mg~2kg)	F ₂ 等级	041	11651005200002广东中 准检测	2023-05-19
砝码F1级(1kg~5kg)	F ₁ 级	349	214104511深圳市计量 院	2023-09-25

4. 校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点： 本客户（实验室）

Operation Location

环境条件： 温度 26.3 °C 相对湿度 58 %

Operation Environment

5. 建议下次校准日期： 2023年06月27日

Next calibration date is recommended

6. 校准结果： 所校准项目符合技术要求/Calibrated project meets technical requirements

Calibration results

校准结果

Result of Calibration

证书编号: 22UA016890003

Certificate No.

第 3 页 共 3 页

Page of

1、外观及各部分相互作用:	正常		
Appearance and interreaction:	Pass		
2、最大称量: 5000 g	最小称量: 2 g		
Maximum weighting	Minimum weighting:		
3、实际分度值(d): 0.01 g	检定分度值e: 0.1 g		
Actual scale	Calibration scale:		
4、重复性: 0.00 g	允差: ≤ 0.15 g	结论: P	
Repeatability	MPE	Conclusion	
5、偏载误差: +0.01 g	允差: ± 0.15 g	结论: P	
Eccentric load error	MPE	Conclusion	
6、称量测试 (Weighing test) :			

单位	参考值	进程示值	回程示值	误差	允许误差	结论
Unit	Ref. Value	Course	Backhaul	Error	MPE	Conclusion
g	2	2.00	2.00	0.00	± 0.05	P
	50	50.00	50.00	0.00	± 0.05	P
	200	200.01	200.01	0.00	± 0.10	P
	2500	2500.02	2500.02	0.00	± 0.15	P
	5000	5000.04	5000.04	0.00	± 0.15	P

7、鉴别力测试/Differentiate force test: 通过/Pass

备注(Notes):

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子k。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

$$U = 0.01 \text{ g} \quad (k=2)$$

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)