


校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: 22UA016890001

第 1 页共 3 页
Page of客 户 名 称 : 四川正翔建筑装饰工程有限公司
Name of Customer客 户 地 址 : 四川省德阳市珠江西路28号学生公寓3楼
Address of Customer计 量 器 具 名 称 : 绝缘电阻测试仪
Name of Instrument规 格 / 型 号 : ZC25-1000W
Type/Specification制 造 单 位 : /
Manufacturer出 厂 编 号 : /
Serial No.管 理 编 号 : ZXJZ-02
Regulation Number批准人
Approved by 赵广辉职 务
Post 工程师委 托 日 期 2022 年 06 月 25 日
Received Date Year Mon Day校 准 日 期 2022 年 06 月 28 日
Calibration Date Year Mon Day核 验 员
Checked by 魏宇成签 发 日 期 2022 年 06 月 29 日
Issue Date Year Mon Day校 准 员
Calibrated by 许光

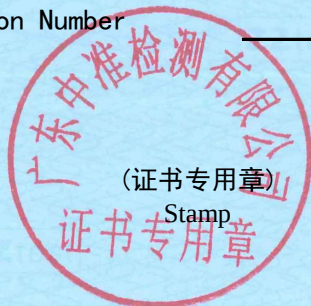

校准说明
Directions of Calibration

证书编号： 22UA016890001
Certificate NO.

第 2 页 共 3 页
Page of

1. 本证书校准结果只与被校准仪器有关，带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with "*" is beyond the scope of our laboratory accreditation

2. 本次校准的技术依据：

Reference documents for the calibration:

参照JJG 622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》

3. 本次校准所使用的主要计量标准器具信息：

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	不确定度或最大允差 或准确度等级 Uncertainty of Measurement or Maximum Permissible Errors	设备编号 Certificate No.	证书号/溯源单位 certificate No/Traceality to	有效日期 Due Date
兆欧表检定装置ZX119-8	$U_{rel}=0.06\% \quad (k=2) \quad 0.2$ 级	09791	223201272深圳计量院	2023-02-17
数字高压表149-10A	ACV: $\pm 1\%$, DCV: $\pm 0.5\%$	HH003334	213503026深圳市计量院	2022-07-08

4. 校准/检测地点、环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点： 本客户（实验室）

Operation Location

环境条件： 温度 26.3 °C 相对湿度 58 %

Operation Environment

5. 建议下次校准日期： 2023年06月27日

Next calibration date is recommended

6. 校准结果： 所校准项目符合技术要求/Calibrated project meets technical requirements

Calibration results

校准结果
Result of Calibration证书编号: 22UA016890001
Certificate No.第 3 页 共 3 页
Page of1、外观及各部分相互作用: 正常
Appearance and interreaction: Pass

2、绝缘电压校准/Insulation voltage calibration:

设定值	实测值	误差	允许误差	结论
Setting	Actual	Error	MPE	Conclusion
(V)	(V)	(V)	(V)	(P/F)
50	50	0	±1	P
100	101	-1	±2	P
250	251	-1	±5	P
500	502	-2	±10	P
1000	1002	-2	±20	P

3、绝缘电阻校准/Insulation resistance calibration:

测试电压	标准电阻	仪表示值	误差	允许误差	结论
Test Voltage	Standard Output	Indication Value	Error	MPE	Conclusion
(V)	(MΩ)	(MΩ)	(MΩ)	(MΩ)	(P/F)
1000	1	0.99	-0.01	±0.05	P
	2	1.98	-0.02	±0.10	P
	5	4.98	-0.02	±0.25	P
	10	10.2	+0.2	±0.5	P
	20	20.2	+0.2	±1.0	P
	50	50.2	+0.2	±2.5	P
	100	101	+1	±5	P
	200	205	+5	±10	P
	500	505	+5	±25	P
	1000	1012	+12	±50	P

备注 (Notes):

1.测量结果扩展不确定度

(Expanded uncertainty of the measurement results)

1.1电压(Voltage): $U_{rel}= 0.8\%$ (k=2)1.2电阻(Resistance): $U_{rel}= 1.3\%$ (k=2)

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)