


测量过程核查记录


表格编号：R-7.2/01

测量过程名称：	电阻测试			测量过程编号：		PZ-004-D-02			记录流水号：202201			
测量参数：	电阻值			测量最大允许误差：		±1 Ω			备注：单位为 Ω			
核查标准：	标准电阻（100 Ω）			核查周期：		每月一次						
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 ($\frac{\quad}{X}$)	标准偏差 (s)
2022年3月	100.2	100.1	100.1	100.0	100.2	100.1	100.2	100.1	100.0	100.1	100.10	0.06
2022年4月	100.0	100.1	100.1	100.0	100.1	100.1	100.2	100.1	100.1	100.0	100.09	0.06
2022年5月	100.0	100.1	100.0	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.2	100.2	100.08	0.06
2022年6月	100.1	100.0	100.1	100.1	100.2	100.0	100.1	100.1	100.2	100.0	100.08	0.06
2022年7月	100.2	100.1	100.1	100.1	100.1	100.1	100.2	100.1	100.1	100.0	100.11	0.04

\bar{X} - s图

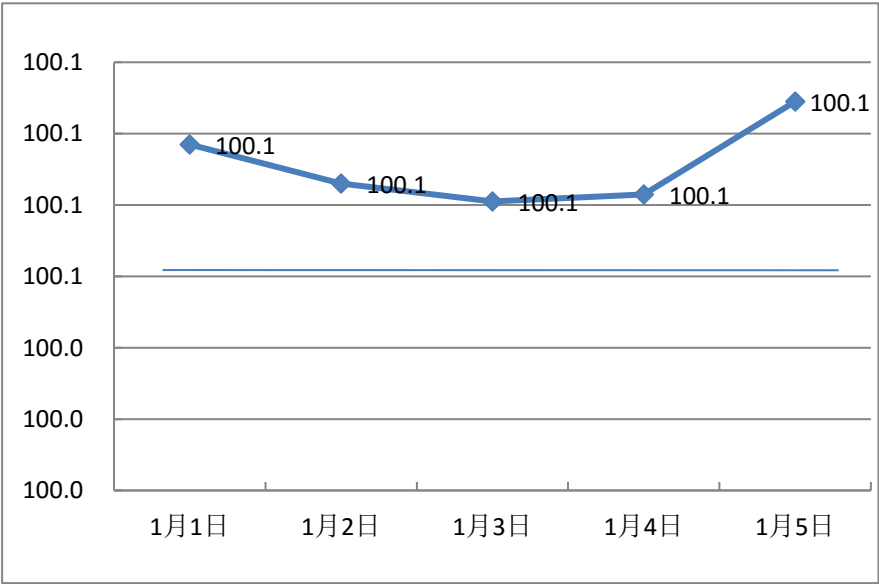

s图



编制/日期： 曾强2022.7.8

审核/日期： 龚丰兢2022.7.8

