

南通市水表计量检定站

Nantong Water Meter Measurement And Verification Station

证书编号:

21355

Certificate No.

检定证书

Verification Certificate

证书编号: 21355

Certificate No. _____

送检单位

Applicant

江苏德高物联技术有限公司

计量器具

Name of Instrument

冷水水表

型号/规格

Type/Specification

DG-FW001-50

出厂编号

Serial No.

DG-20086246

制造单位

Manufacturer

江苏德高物联技术有限公司

检定依据

Verification Regulation

JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》

检定结论

Conclusion

合格



批准人
Approved by

陈企宁

陈企宁

核验员
Checked by

陈永庆

陈永庆

检定员
Verified by

朱燕

朱燕

检定日期

Verification date

21 年 3 月 24 日

Year Month Day

有效期至

Valid until

25 年 3 月 23 日

Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (通)法计(2020)2001-1号

Authorization Certificate No.(2020)2001-1

地址: 南通市濠西路28号

28 Haoxi Road, Nantong

电话/传真: 0513-85792015

Tel.

邮编: 226001

Post Code



扫描全能王 创建

南通市水表计量检定站

Nantong Water Meter Measurement And Verification Station

证书编号:

21355

Certificate No.

本站是法定授权计量检定机构, 计量授权证书号: (通) 法计 (2020) 2001-1号。

This station is a legally authorized metrological verification institution, Authorization Certificate No.(2020)2001-1

检定地点及其环境条件

Place and environmental conditions of the verification

地点: 南通市濠西路28号水表计量检定站一楼实验室

Place

环境温度:

18

°C

相对湿度:

68

%

Ambient Temperature

Relative Humidity

使用的计量标准装置

Measurement standard device used

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 Uncertainty of Measurement/Class of Accuracy	标准证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid to
水表检定装置	流量: (4~300000) L/h	0.2级	【2001】市量 标通授证字第 010301号	2024年4月8日

检定使用的计量标准器

Metrological standard used in verification

名称 Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级 Uncertainty of Measurement/Class of Accuracy	标准证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid to
水表检定装置	DN (15-50)	0.2级	920013945-004	2022年7月1日

本站出具的数据均可溯源至国家计量基准。

All data issued by this station can be traced back to the national measurement standard.

注: 1、未经本站批准, 部分采用本证书内容无效。

Statement: Partly using this certificate will not be admitted unless allowed by the station.

2、本证书的检定结果仅对本次的检定器具有效。

The results of this certificate are only responsible for the item verified.

3、本证书未加盖检定专用章无效。

The certificate is invalid without official stamp.



扫描全能王 创建

南通市水表计量检定站

Nantong Water Meter Measurement And Verification Station

证书编号:

21355


Certificate No.

检定结果

Verification Results

检定项目 Verification Items	结论 Conclusion
外观、标志和封印	符合要求
电子装置功能	符合要求
密封性	符合要求
示值误差	Q1:-0.19% Q2:-0.25% Q3:-0.61%
附加说明	1. 水表的准确度等级为2级。 2. 本次检定为首次检定

以下空白

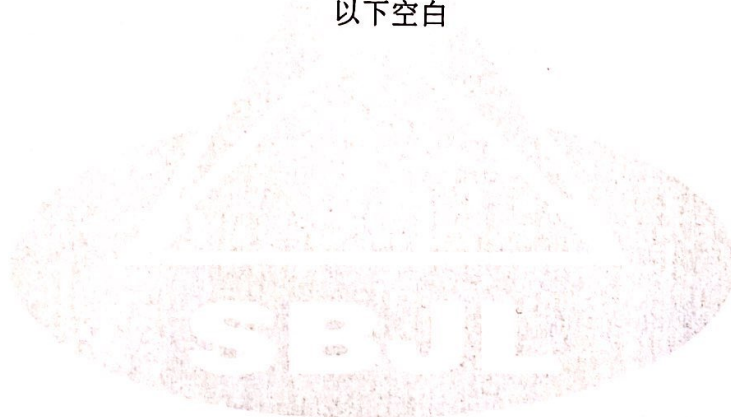

扫描全能王 创建