
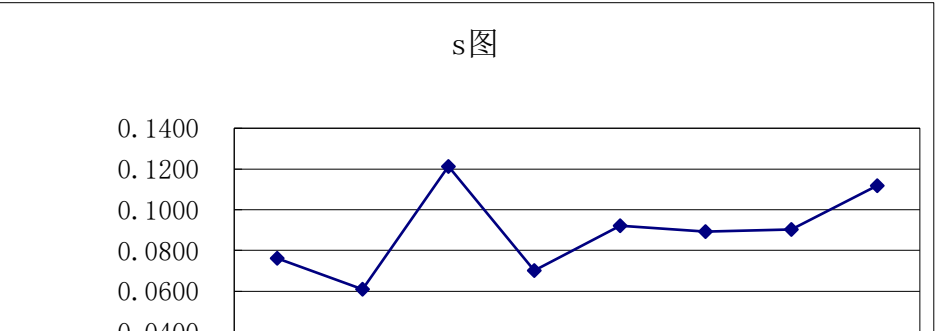


测量过程核查记录

编号：JR/JL01-005


测量过程名称：	2级智能水表出厂示值误差检验过程					测量过程编号：		PG-06				
测量参数：	示值误差			测量最大误差：		±0.5%			备注：单位为%			
核查标准：	标准水表			核查周期：		每月1次						
核查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均值 $\overline{X}$)	标准偏差 (s)
2022年1月	0.170	0.140	-0.026	0.125	0.110	-0.002	0.133	0.171	0.005	0.160	0.10	0.08
2022年2月	0.146	0.136	0.018	0.195	0.178	0.135	0.114	0.018	0.067	0.125	0.11	0.06
2022年3月	-0.060	-0.175	0.114	0.106	0.134	-0.086	0.127	0.156	0.168	0.135	0.06	0.12
2022年4月	0.170	0.170	0.026	0.125	0.110	0.002	0.134	0.173	0.005	0.162	0.11	0.07
2022年5月	0.161	0.140	0.135	0.185	0.052	0.104	0.100	0.112	-0.146	0.084	0.09	0.09
2022年6月	0.098	-0.138	0.094	0.174	0.113	0.095	0.132	0.099	0.184	0.138	0.10	0.09
2022年7月	0.087	0.140	0.125	0.195	0.179	0.116	-0.118	0.083	0.192	0.131	0.11	0.09
2022年8月	0.174	-0.126	0.183	0.168	0.084	0.116	-0.100	0.146	0.116	0.149	0.09	0.11

$\bar{X}$ -s图

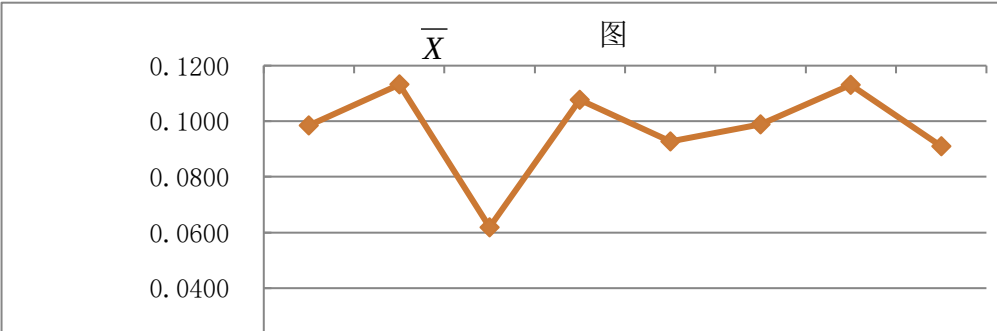



制表： 刘力2022.8.29

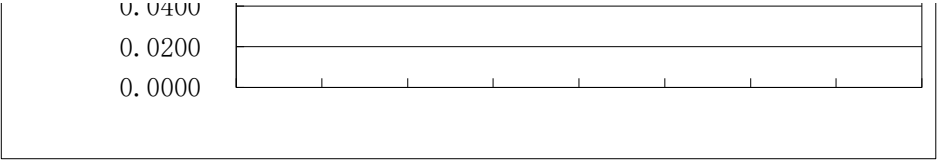

审核/日期： 栗占川 2022.8.29