
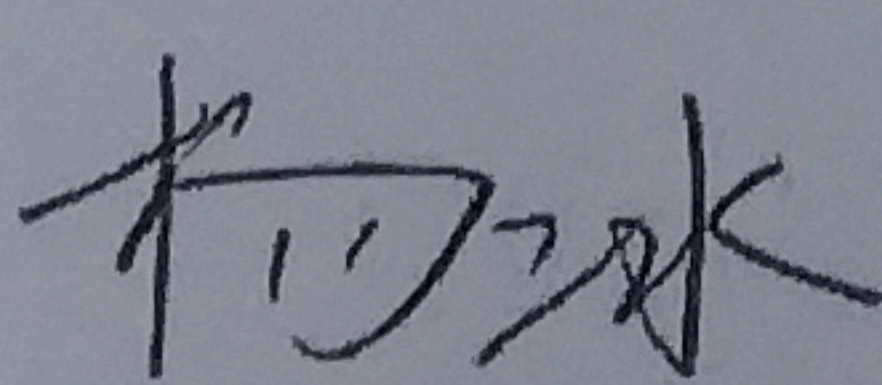
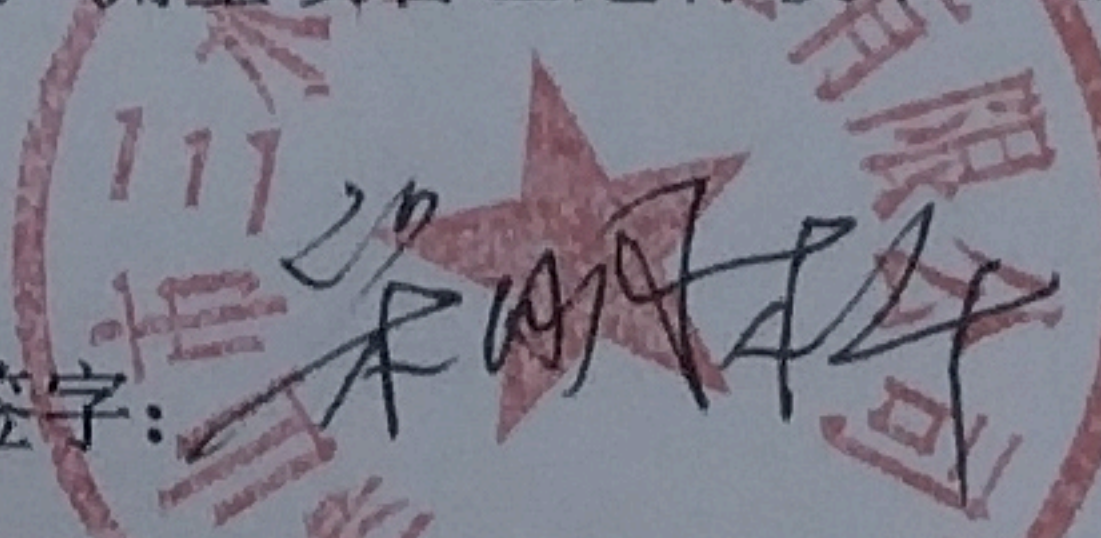


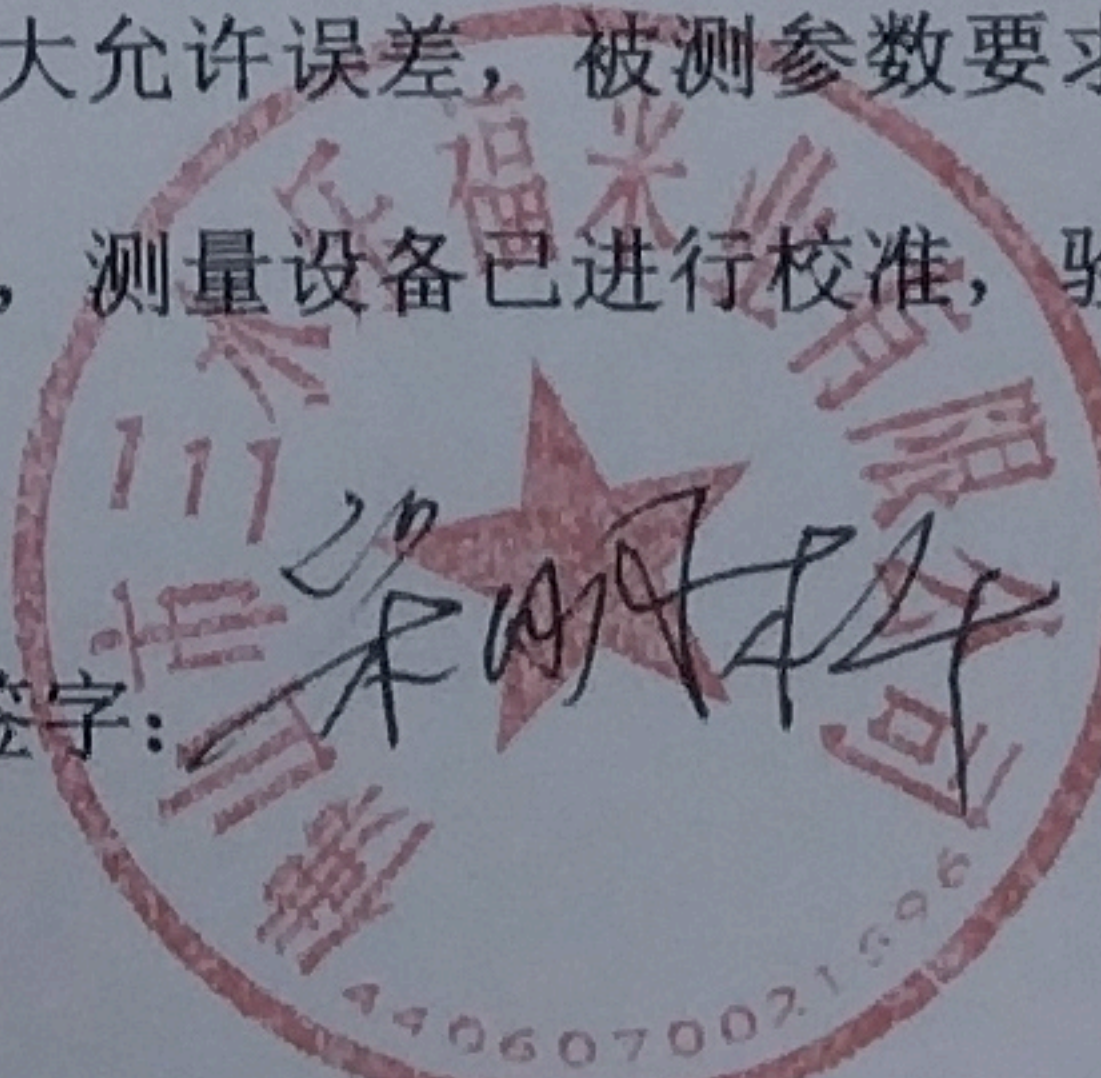

编号：1073-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	大米水分测定过程	被测参数要求(含公差)	大米水分 $\leq 14.5\%$		
被测参数要求识别依据文件		GB/T 1354-2018《大米》			
计量要求导出方法（可另附） 根据国标要求大米水分 $\leq 14.5\%$ 一般检测结果范围：（12-14）%，T=2% 测量过程计量要求： 测量范围：（8-14）% 不确定度： $U_{\text{允}} \leq 2/3 \approx 0.6\%$ 测量设备计量要求： 根据检测方法 GB5009.3-2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》第一法直接干燥法，选用电热恒温干燥箱，天平（感量为 0.1mg）					
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	干燥箱/0249	202-1	-80℃~200℃偏差： $\pm 2^\circ\text{C}$	SZ922018281	2022.7.25
	机械天平/9532	TG328A	I 3 级，d=0.1mg	SZL922018288	2022.7.25
计量验证记录 已经根据检测标准中的检测方法中对测量设备的要求选择测量设备，测量设备的测量范围满足要求，测量设备的示值误差小于测量设备最大允许误差，满足计量要求。 验证结论： ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 叶敏锋 验证日期：2022 年 11 月 20 日					
审核记录： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员签名：  企业代表签字：   审核日期：2022 年 11 月 25 日					