



编号: 1266-2022

不符合项报告

企业名称:	广州市新兴电缆实业有限公司	不符合报告编号:	2023010401
受审核部门: 质量管理部		陪同人员: 曾裕焯	
不符合事实描述: 抽查质量管理部热延伸实验烘箱 (编号 401843) 的校准机构广东中准检测有限公司, 没有纳入计量合格外部供方管理。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.4 外部供方 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒ _____; 审核员(签名) <u>李新</u> 陪同人员(签名) <u>曾裕焯</u> 企业部门代表(签名) <u>李新</u> 日期: 2023 年 1 月 4 日			
纠正措施: 1. 将广东中准检测有限公司纳入计量合格外部供方管理, 并对其进行供方评价。 2. 检查是否有其他机构没有纳入供方管理, 如有, 及时纳入管理实施评价。 企业部门代表签名: <u>李新</u> 审核员签名: <u>李新</u>			
纠正措施完成情况: 已分析原因, 制定纠正措施, 经验证有效, 同意关闭不符合项。 审核组代表签名: <u>李新</u> 日期: 2023. 1. 6			

可另附页

广州市新兴电缆实业有限公司检测中心

供应商调查评价表

XXTC/RD-11-1

供应商名称		广东中准检测有限公司			
供应商地址		广东省深圳市南山区西丽沙河西路 5298 号百旺研发大厦 1 栋 11 楼 1110 室			
联系电话		0755-26718832		负责人	
质量体系情况		认证证书编号		赵广辉	
CNAS		L0239		2023/02/26	
序号	提供产品/服务	校准规范	测量范围	扩展不确定度	
1	数显卡尺校准	JJG 30 通用卡尺	(0~2000) mm	分度值 0.01mm	
2	数显外径千分尺校准	JJG21 千分尺 鉴定规程	(0~25) mm	U=1.3 μm	
3	工频绝缘耐压试验机校准	JJG 795 耐压测试仪 检定规程	电压 AC:0.1kV~10kV, (45~65) Hz	Urel=1.2%	
			电流 AC:0.1mA~100mA, (45~65) Hz	Urel=1.3%	
			时间: 1s~100s	Urel=1.0%	
4	串联谐振局放试验系统校准	高电压耐压测试仪 检定规程 JJG (军工) 18	交流电压: 0.1kV~100kV (45~65) Hz	Urel=1.6%	
			时间: 1s~60s	1s~60s	
5	测厚仪校准	橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488	(0~10) mm	U=0.01mm	
6	电缆半导电阻测试仪校准	JJG 837 直流低阻表 检定规程	1mΩ~100kΩ	1mΩ~100kΩ	
7	直流电阻测量仪校准	JJG 837 直流低阻表 检定规程	1mΩ~100kΩ	1mΩ~100kΩ	
8	温度、湿度环境试验设备	环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101	(0~300) °C	U=(0.3~1.0) °C	
校准能力是否满足要求		☒ 是 ☐ 否	是否有能力在规定时间内提供服务		☒ 是 ☐ 否
评审结论		经调查， ☒ 建议列为合格供应商。 ☐ 不符合条件，不能列为合格供应商。			

编制: 肖俊海
 时间: 2023.1.5

审核: 文春城
 时间: 2023.1.5

批准: 肖俊海
 时间: 2023.1.5

机构基本信息:

广东中维检测有限公司

注册编号: 10239	
具有法人资格的机构名称:	
报告/证书/样使用/可标定的其他名称:	
邮政编号: 518057	联系电话: 0755-26718332
网站地址: www.zwtest.com.cn	传真号码: 0755-26344550
电子邮箱: 362751@qq.com	
单位地址: 广东省深圳市南山区西丽沙河西路328号百旺研发大厦1楼110室	
认可有效期至: 2017-02-26 — 2023-02-26	
认可依据: ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》以及CMAA特定认可要求	

证书附件 (能力范围):


结构化数据: 已正式公布的结构化能力范围 注: 测量仪器 标注有“*”的项目可开展现场校准。

证书附件 (能力范围) 数据列表:

任务编号	评审类型	签发日期	结构化能力范围的公布状态	word版附件信息
100811-2020-01Z	复评-扩项-不定期监督	2021-05-21	正式公布	

提示: 机构的认可范围详细信息请查看证书附件 (能力范围)。

关闭窗口



营业执照

统一社会信用代码 914403007270465017

名称 广东中准检测有限公司
主体类型 有限责任公司（自然人独资）
住所 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
法定代表人 赵广辉
成立日期 2001年02月20日

重要提示



- 1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关

2016 年 09 月 26 日



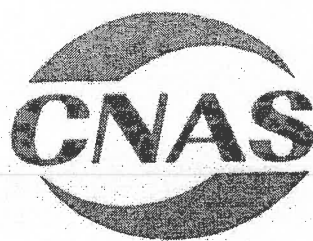

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L0239)

兹证明:

广东中准检测有限公司

(法人: 广东中准检测有限公司)

广东省深圳市南山区西丽沙河西路 5298 号百旺研发大厦 1


栋 11 楼 1110 室, 518057

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2019-02-25

截止日期: 2023-02-26



中国合格评定国家认可委员会授权人

朱平

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太实验室认可合作组织 (APLAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明
11	*温度、湿度环境 试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度校准规范 JJF 1101	(0~300) °C	$U=(0.3\sim1.0) ^\circ\text{C}$	
12	机械式温湿度计、温湿度记录仪	温度 湿度	机械式温湿度计检定规程 JJG 205	(0~50) °C 30%RH~95%RH (20 °C)	$U=0.3 ^\circ\text{C}$ $U=2\%\text{RH}$ (20 °C)	
13	*盐雾试验箱	温度 盐雾沉降率	盐雾试验箱校准规范 JJF (辽) 75	(25~50) °C (0.6~4.0) mL/(h•80cm ²) (-30~0) °C	$U=0.3 ^\circ\text{C}$ $U=0.24\text{mL}/(\text{h}\cdot80\text{cm}^2)$ $U=0.07 ^\circ\text{C}$	
14	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130	(0~95) °C (95~300) °C	$U=0.03 ^\circ\text{C}$ $U=0.15 ^\circ\text{C}$	
15	工业铂、铜热电阻	温度	工业铂、铜热电阻检定规程 JJG 229	0 °C 100 °C	$U=0.046 ^\circ\text{C}$ $U=0.085 ^\circ\text{C}$	
16	*温度变送器 (不带传感器)	温度	温度变送器校准规范 JJF 1183	(-200~1600) °C (-30~0) °C	$U=0.3 ^\circ\text{C}$ $U=0.6 ^\circ\text{C}$	
17	双金属温度计	温度	双金属温度计检定规程 JJG 226	(0~95) °C (95~300) °C	$U=0.5 ^\circ\text{C}$ $U=0.6 ^\circ\text{C}$	

No. CNAS L0239



在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明
18	数字温度计(带传感器)	温度	数字温度计校准规范 JJF(苏)95	(-30~300)℃	$U=0.1^{\circ}\text{C}$	
19	数字温湿度计	温度 湿度	数字温湿度计检定规程 JJG(苏)99	(-10~50)℃ 10%RH~95%RH (20℃)	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ $U=2\%\text{RH}$ (20℃)	
20	电接点玻璃水银温度计	温度	电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG 131	(-30~0)℃ (0~95)℃ (95~300)℃	$U=0.1^{\circ}\text{C}$ $U=0.07^{\circ}\text{C}$ $U=0.12^{\circ}\text{C}$	
21	表层水温表	温度	表层水温表检定规程 JJG 289	(-30~50)℃ (-30~0)℃	$U=0.06^{\circ}\text{C}$ $U=0.6^{\circ}\text{C}$	
22	压力式温度计	温度	压力式温度计检定规程 JJG 310	(0~95)℃ (95~300)℃	$U=0.5^{\circ}\text{C}$ $U=0.6^{\circ}\text{C}$	
23	廉金属热电偶	温度	廉金属热电偶校准规范 JJF 1637	(-30~1100)℃	$U=0.4\sim 1.1^{\circ}\text{C}$	
24	工作用铜-铜镍热电偶	温度	工作用铜-铜镍热电偶检定规程 JJG 368	(-30~300)℃	$U=(0.2\sim 0.6)^{\circ}\text{C}$	
25	铠装热电偶	温度	铠装热电偶校准规范 JJF 1262	(-30~1100)℃	$U=(0.4\sim 1.1)^{\circ}\text{C}$	
26	温度巡回检测仪	温度	温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171	(-30~300)℃	$U=0.2^{\circ}\text{C}$	

No. CNAS L0239



在二维码处获取验证