



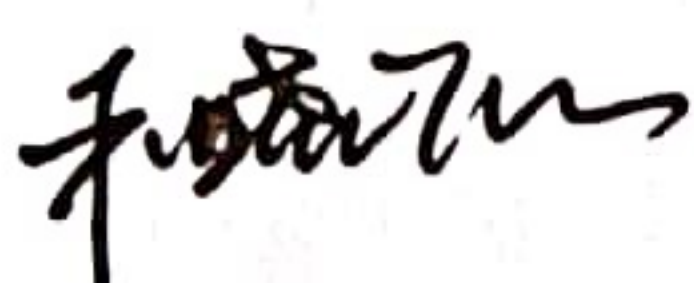
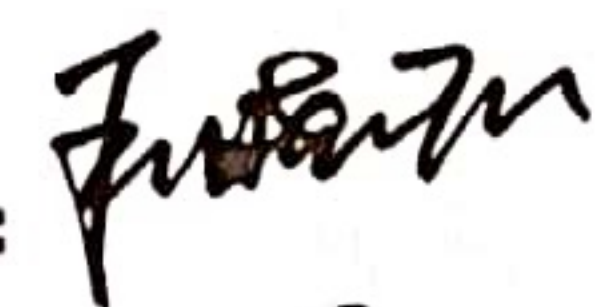
不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS 监查 1		
受审核方	江西科鸿新材料科技有限公司		
受审核部门	生产 部	陪同人员	王捷

不符合事实描述:

未能提供对水分检测仪进行校准或验证的相关证据

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般审核员: 
日期: 2020.9.20审核组长: 
日期: 2020.9.20受审核方代表: 
日期: 2020.9.20

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

培训记录
设备校准报告
纠正措施有效

审核员: 

日期: 2020年10月20日



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 水分检测仪未校准
纠正情况: 安排人员送检
原因分析: 相关人员对标准培训不到位
纠正措施: 组织相关人员进行培训 预定完成日期: 2020 年 11 月 19 日前
举一反三检查情况: 检查质量管理体系其他环节是否有类似不符合, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 培训有效, 未发生类似不符合 验证人: 黄彭量 日期: 2020 年 10 月 20 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：各部门负责人及相关人员		部门：生产部	受训日期：2020.10.20
受训内容：外审不符合关闭			
评估人：黄彭量		评估日期：2020.10.20	
受训人填写部分			
1、你是否从中学到了知识	☒ 是 ☐ 否 其它		
2、工作绩效是否有所提高	☒ 是 ☐ 否 其它		
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训师）	无		
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用	☒ 是 ☐ 否 其它		
评估人填写部分			
1、是否有对学员进行书面考核	☐ 是 ☒ 否 考核成绩		
2、学员培训中的出勤状况	迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它良好		
3、培训中学员的态度	☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差		
4、培训中学员的互动情况	☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 差		
5、学员对培训项目的反映	☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差		
6、学员是否运用到培训中所学的技能	☒ 是 ☐ 否 其它		
7、学员工作绩效是否有所提高	☒ 是 ☐ 否 其它		
8、学员绩效提高与培训相关	☒ 是 ☐ 否 其它		
9、学员工作是否有创新	☐ 是 ☐ 否 其它		
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果	☒ 是 ☐ 否 其它		
评估人综合评价：培训效果良好			
签名：黄彭量			
日期：2020.10.20			



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:
Certificate No.: HK2010151900

委托方:
Client: 江西科鸿新材料科技有限公司

委托方地址:
Address: 江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园

仪器名称:
Description: 水份检测仪

型号/规格:
Model/Type: SF-A1

制造商:
Manufacturer: 南威仪器表有限公司

出厂编号:
Serial No.: /

管理编号:
Asset No.: KH-001

校准日期:
Calibration Date.: 2020 年 10 月 15 日
Y M D

校准:
Calibrated by: 林贞杰

核 验:
Inspected by: 吴琼

批 准:
Approved by: 江伟俊

发证单位 (专用章):
Issued By (Stamp):



地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编 (Post Code): 518104

电话 (Tel): 0755-27883026

传真 (Fax): 0755-27883736

网址 (Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件 (E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号

校 准 说 明

证书编号: HK2010151900

DIRECTIONS OF CALIBRATION

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.:

Page

of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company .
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory.Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 986-2004《木材含水率测量仪检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设 备 名 称	编 号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
标准物质	GBW(E) 130417	GBW(E) 081634-081638/2021-07-09	-----

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 客户实验室
Place of calibration:

温 度: 21 °C 相对湿度: 55 %RH
Temperature: Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件: *表示可能部分/全部超出我司CNAS能力范围。
Limiting condition of the instrument meterage: *Representation beyond capacity.

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK2010151900
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 符合要求

二、示值误差校准:

标准值 (%)	示值 (%)	示值误差 (%)
10	10.03	0.03
15	15.05	0.05
20	20.07	0.07
30	30.09	0.09
35	35.10	0.10

三、说明(Note):

1. 结论: 参照校准结果使用。

Conclusion: Use reference calibration results.

2. 本次测量结果的相对扩展不确定度为: $U_{rel}=1.0\%$, $k=2$

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U_{rel}=1.0\%$, $k=2$

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以 下 空 白)

(The below is blank)