



监督审核移交记录清单

受审核方：九江汇泰科技有限公司 合同号：0311-2019-Q-2020

审核领域：■QMS□50430□EMS□OHSMS

审核类型：监查

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1 份	√	
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份	√	
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份	√	
4	ISC-B-II-04	文件评审报告（适用时）	2	1 份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份	√	需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份	√	
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份	√	
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份	√	需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首末次会议签到表及会议记录	1	1 份	√	
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份	√	不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料（复印件）				√	
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份	√	
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2	√	企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份	√	
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项（建议项）报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书（适用时）	1	2 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注						



组长签字：

日期

2020.9.21



审核计划

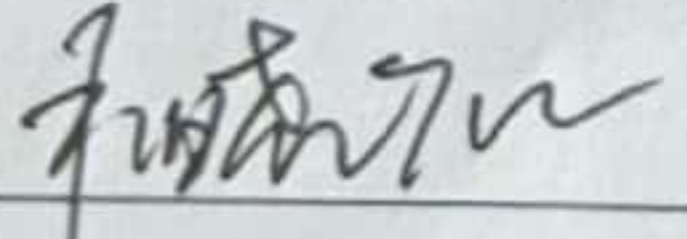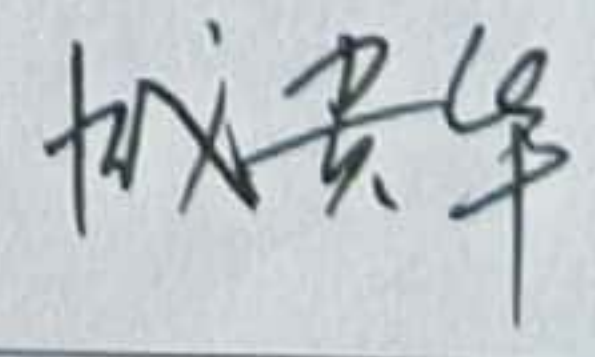受审核方	九江汇泰科技有限公司					
受审核方地址	江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区					
联系人	石贵云	联系电话	0792-5361788	邮编		
最高管理者	石贵云	传真		邮箱		
合同编号	0311-2019-Q-2020	审核领域	■QMS□50430□EMS□OHSMS			
审核类型	监查 1					
审核目的	☐ 认证注册：_____ ☒ 保持认证注册资格：_____ ☐ 恢复认证注册资格：_____ ☐ 扩大认证范围：_____ ☐ 其它：_____。					
审核范围	红外线陶瓷板、多孔陶瓷板、蜂窝状陶瓷的生产			专业代码	15.03.02	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3 ☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款: ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO45001: 2018 标准 ■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2020 年 09 月 27 日上午至 2020 年 09 月 27 日下午, 共 1.0 天。					
审核语言	■ 普通话□英语□其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
朱晓丽	女	组长	审核员	2018-N1QMS-2205805		ISC-205805
王隆生	男	组员	专家	萍乡市中源瓷业有限公司	15.03.02	ISC-JSZJ-015
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长						
联系电话	15011335853					
日期	2020.9.26		日期 2020.9.26			



现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 九江汇泰科技有限公司

项目号: 0311-2019-Q-2020

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2020年9月27日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	王瑞生	组员	
专业审核员		组员	
专家	王瑞生	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	石贵云	生产部	管代	8			
2	李恩宇	销售部	经理	9			
3	柳燕飞	财务部	主任	10			
4	李洁峰	采购	总经理	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

☐ 双方介绍人员;☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;☒ 确认企业的保密事宜;☐ 确认审核组的安全及应急情况对策;☒ 介绍审核报告的方法及步骤;☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

王瑞生 2020.9.27



末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：九江汇泰科技有限公司

项目号：231-2019-Q-2020

2. 会议类型： ☐ 末次会议

会议时间：2020年9月27日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	和成军	组员	
专业审核员		组员	
专家	毛纯生	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	石贵云	生产部	管代	8			
2	李恩宇	销售部	经理	9			
3	柳燕飞	财务部	主任	10			
4	李洁峰	采购	总经理	11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

和成军 9.27



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：


2020.9.27



廉洁自律声明


一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

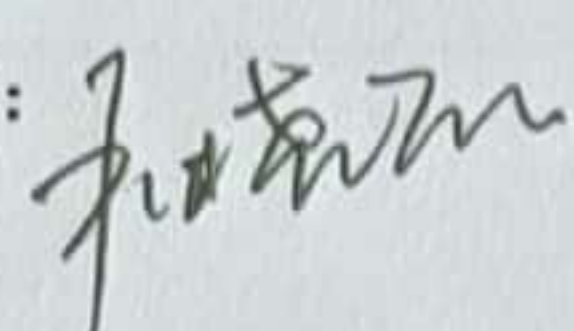签字: 

日期: 2020.9.27


二、受审核方声明:

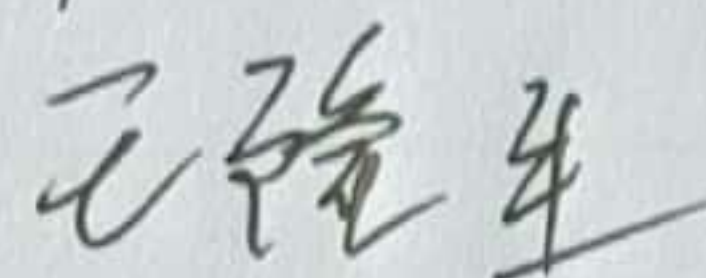

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

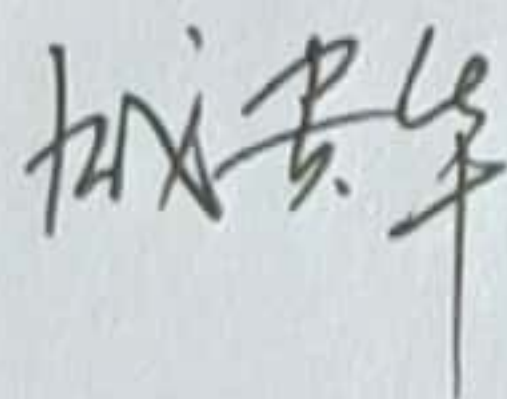



受审核方盖章

2020 年 9 月 27 日



审核员报销费用清单

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			

本次审核，_____在受审核方报销费用清单如下：

项目名称	日期	始发站、终点站	金额
飞机票			
火车票			
出租车票			
杂费（注明）			
合 计			



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNA S L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK1912160653

委托方:

Client:

九江汇泰科技有限公司

委托方地址:

Address:

江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

仪器名称:

Description:

电子台秤

型号/规格:

Model/Type:

150kg

制造商:

Manufacturers:

哈尔滨众汇衡器有限公司

出厂编号:

Serial No.:

/

管理编号:

Asset No.:

HT-006

校准日期:

Calibration Date.:

2019

年

Y

12

月

M

16

日

D

校准:

Calibrated by:

邓钟文

核验:

Inspected by:

林洁虹

批准:

Approved by:

江伟俊

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

证书专用章

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: 5/F, Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



扫描全能王 创建

校准说明

证书编号: HK1912160653

DIRECTIONS OF CALIBRATION

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.:

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI).
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
砵码组	002312	1803876/2020-02-27	F1级

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室
Place of calibration:

温度: 22 °C
Temperature:

相对湿度: 55 %RH
Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件: *表示可能部分/全部超出我司CNAS能力范围。

Limiting condition of the instrument meterage: *Representation beyond capacity.



扫描全能王 创建

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK1912160653
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 外观合格, 功能正常

二、示值误差(kg): (Max=150kg d=0.01kg)

标准值	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
1	1.00	0.00	± 0.05	P
2	2.00	0.00	± 0.05	P
50	50.00	0.00	± 0.05	P
100	100.01	0.01	± 0.10	P
120	120.02	0.02	± 0.10	P
150	150.02	0.02	± 0.10	P

三、重复性误差 (kg):

试验载荷	重复性	允许误差	结论 (P/F)
75.00	0.01	≤ 0.10	P

四、偏载误差(kg):

砝码位置如下图		试验载荷	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
1	2	50	50.01	0.01	± 0.05	P
		50	50.02	0.02	± 0.05	P
4	3	50	50.02	0.02	± 0.05	P
		50	50.02	0.02	± 0.05	P

五. 说明 (Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion: The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=20g$, $k=2$.

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=20g$, $k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以下空白)

(The below is blank)



扫描全能王 创建



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK1912160651

委托方:

Client:

九江汇泰科技有限公司

委托方地址:

Address:

江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

仪器名称:

Description:

涂四粘度计

型号/规格:

Model/Type:

LND-1

制造商:

Manufacturer:

无锡市瑞平仪器设备有限公司

出厂编号:

Serial No.:

/

管理编号:

Asset No.:

HT-004

校准日期:

Calibration Date.:

2019

年

12

月

16

日

Y

M

D

校准:

Calibrated by:

邓钟文

核验:

Inspected by:

林洁虹

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批准:

Approved by:

江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: 5/F, Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



扫描全能王 创建

校准说明

证书编号: HK1912160651

DIRECTIONS OF CALIBRATION

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.:

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被物件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 1002-2005《旋转黏度计检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
粘度标准物质	E254153	15482545/2020-11-27	$U=0.36\%$

8. 校准地点、环境条件。

Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 22 °C

Temperature:

相对湿度: 55 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

*表示可能部分/全部超出我司CNAS能力范围。

Limiting condition of the instrument metrage: *Representation beyond capacity.



扫描全能王 创建

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK1912160651
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 符合要求

二、示值误差:

转子号	标准液动力粘度 (mPa · s)	示值 (mPa · s)	误差 (%)	允许误差 (%)	结 论 (P/F)
1 [#]	524.06	500	-4.6	±5.0	P
2 [#]	524.06	512	-2.3	±5.0	P
3 [#]	8203.5	7900	-3.7	±5.0	P
4 [#]	8203.5	7800	-4.9	±5.0	P

三、重复性*: 0.9 % ±2.5 允许误差 (%) 结论 (P/F) P

四、再现性*: 1.7 % ±2.5 允许误差 (%) 结论 (P/F) P

五、说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion: The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的相对扩展不确定度为: $U_{rel}=2.8\%$, $k=2$.

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U_{rel}=2.8\%$, $k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.


4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以 下 空 白)
(The below is blank)



扫描全能王 创建



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNA S L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK1912160648

委托方:

Client:

九江汇泰科技有限公司

委托方地址:

Address:

江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

仪器名称:

Description:

烟气分析仪

型号/规格:

Model/Type:

M-900

制造商:

Manufacturer:

上海英盛分析仪器有限公司

出厂编号:

Serial No.:

903301018

管理编号:

Asset No.:

HT-001

校准日期:

Calibration Date.:

2019

年

12

月

16

日

Y

M

D

校准:

Calibrated by:

邓钟文

核 验:

Inspected by:

林洁虹

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

Approved by:

江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: 5/F, Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



扫描全能王 创建

校准说明

证书编号: HK1912160648

DIRECTIONS OF CALIBRATION

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.:

Page

of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。

All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).

2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。

If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.

3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。

The results relate only to the instrument calibrated.

4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。

This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.

5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。

Copies of this report without an official stamp test are not valid.

6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。

Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 968-2002《烟气分析仪检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。

Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
电子秒表	PC396	193101264/2020-04-07	$U=0.01s$

8. 校准地点、环境条件。

Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 22 °C

Temperature:

相对湿度: 55 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

*表示可能部分/全部超出我司CNAS能力范围。

Limiting condition of the instrument meterage: *Representation beyond capacity.



扫描全能王 创建

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK1912160648
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查:

外观合格, 功能正常

二、示值稳定性*:

气体通道	示值相对漂移
O ₂	+0.6%
CO	+1.1%

三、示值误差*:

气体通道	标准气浓度	绝对误差	相对误差 (%)
O ₂ (×10 ⁻²)	5.01	+0.1	+1.6
	12.5	+0.2	+0.7
CO (×10 ⁻⁴)	58.0	+1	+1.5
	90	+1	+0.7

四、示值重复性*:

气体通道	重复性
O ₂	0.5%
CO	0.6%

五、响应时间*:

气体通道	平均值
O ₂	15.1s
CO	18.3s

六、说明(Note):

1. 结论: 参照校准结果使用。

Conclusion: Reference school comprehensive result use.

2. 本次测量结果的相对扩展不确定度为: O₂: $U_{rel}=1.5\%$, CO: $U_{rel}=2.0\%$, $k=2$

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: O₂: $U_{rel}=1.5\%$, CO: $U_{rel}=2.0\%$, $k=2$

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以下空白)

(The below is blank)



扫描全能王 创建



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国合格评定
国家认可委员会
CALIBRATION
CNAS LABORATORY

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK1912160650

委托方:

Client:

九江汇泰科技有限公司

委托方地址:

Address:

江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

仪器名称:

Description:

电子天平

型号/规格:

Model/Type:

BL-3000

制造商:

Manufacturer:

厦门佰伦斯电子科技有限公司

出厂编号:

Serial No.:

154751

管理编号:

Asset No.:

HT-003

校准日期:

Calibration Date.:

2019

年

12

月

16

日

Y

M

D

校准:

Calibrated by:

邓钟文

核 验:

Inspected by:

林洁虹

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

Approved by:

江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: 5/F, Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



扫描全能王 创建

校准说明

证书编号: HK1912160650

DIRECTIONS OF CALIBRATION

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.:

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。
Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
砝码组	002312	1803876/2020-02-27	F1级
砝码	325	184105549/2020-02-27	F1级

8. 校准地点、环境条件。
Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 22 °C

Temperature:

相对湿度: 55 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件: *表示可能部分/全部超出我司CNAS能力范围。

Limiting condition of the instrument meterage: *Representation beyond capacity.



扫描全能王 创建

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK1912160650
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 外观合格, 功能正常

二、示值误差 (g): (Max=15kg d=0.1g)


标准值	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
20	20.0	0.0	± 0.5	P
500	500.0	0.0	± 0.5	P
2000	2000.0	0.0	± 1.0	P
7500	7500.3	0.3	± 1.5	P
15000	15000.5	0.5	± 1.5	P

三、重复性误差 (g):

试验载荷	重复性	允许误差	结论 (P/F)
7500	0.1	≤ 1.5	P

四、偏载误差 (g):

砝码位置如下图:



试验载荷	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
5000	5000.1	0.1	± 1.5	P
5000	5000.0	0.0	± 1.5	P
5000	5000.0	0.0	± 1.5	P
5000	5000.1	0.1	± 1.5	P

五、说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion: The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=10g, k=2$ 。

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=10g, k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以下空白)

(The below is blank)



扫描全能王 创建



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
校准
CALIBRATION
CNA S L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

HK1912160649

Certificate No.:

委托方:

九江汇泰科技有限公司

Client:

委托方地址:

江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

Address:

仪器名称:

U型压力计

Description:

型号/规格:

/

Model/Type:

制造商:

河北省武强县红星仪表厂

Manufacturer:

出厂编号:

/

Serial No.:

管理编号:

HT-002

Asset No.:

校准日期:

2019

年

12

月

16

日

Calibration Date.:

Y

M

D

校准:

邓钟文

Calibrated by:

核 验:

林洁虹

Inspected by:

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批 准:

江伟俊

Approved by:

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



扫描全能王 创建

校准说明

证书编号: HK1912160649

DIRECTIONS OF CALIBRATION

第 2 页, 共 3 页

Certificate No.:

Page of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。
All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).
2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。
If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.
3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。
The results relate only to the instrument calibrated.
4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。
This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.
5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。
Copies of this report without an official stamp test are not valid.
6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。
Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。

Main standards of measurement used this calibration.

设备名称	编号	证书号/有效期	计量特性
Name of Equipment	Serial No	Certificate No./Due Date	Metrological Characteristic
压力表校验仪	SB6012	174381644/2020-02-27	---

8. 校准地点、环境条件。

Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 22 °C

Temperature:

相对湿度: 55 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

*表示可能部分/全部超出我司CNAS能力范围。

Limiting condition of the instrument meterage: *Representation beyond capacity.



扫描全能王 创建

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK1912160649
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观检查: 符合要求

二、示值校准*:

标称值 (kPa)	实测值 (kPa)	误差 (kPa)
-5000	-4990	-10
-4000	-3990	-10
-3000	-2990	-10
-2000	-1990	-10
-1000	-990	-10
0	10	-10
1000	1010	-10
2000	2010	-10
3000	3010	-10
4000	4010	-10
5000	5010	-10

三、说明(Note):

1. 结论: 参照校准结果使用。

Conclusion: Use reference calibration results.

2. 本次测量结果的相对扩展不确定度为: $U_{rel}=0.5\%FS$; $k=2$.

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U_{rel}=0.5\%FS$; $k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以下空白)
(The below is blank)



扫描全能王 创建



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNA S-L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页
Page of

证书编号:

Certificate No.:

HK1912160652

委托方:

Client:

九江汇泰科技有限公司

委托方地址:

Address:

江西省九江市都昌县蔡岭镇蔡岭工业园区

仪器名称:

Description:

电子计价秤

型号/规格:

Model/Type:

ACS-30

制造商:

Manufacturer:

永康市永州衡器有限公司

出厂编号:

Serial No.:

436829

管理编号:

Asset No.:

HT-005

校准日期:

Calibration Date.:

2019

年

12

月

16

日

Y

M

D

校准:

Calibrated by:

邓钟文

核验:

Inspected by:

林洁虹

发证单位(专用章):

Issued By (Stamp):

批准:

Approved by:

江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦。

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.

邮编(Post Code): 518104

电话(Tel): 0755-27883026

传真(Fax): 0755-27883736

网址(Web): <http://www.stsjt.vip>

电子邮件(E-mail): huakejiliangVIP@163.com



公众号



扫描全能王 创建

校 准 说 明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

第 2 页, 共 3 页

证书编号: HK1912160652

Certificate No.:

Page

of

1. 本实验室所出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI)。

All data issued by this laboratory are traceable to national primary standards and International System of Units(SI).

2. 对本次测量若有异议, 委托方应于收到被测件之日起十五日内向本公司提出。

If there is any objection concerning the measurement, the client shall, within fifteen days from the date of receipt of the test piece, put forward to the company.

3. 本证书校准结果仅与受校准仪器有关。

The results relate only to the instrument calibrated.

4. 未经本实验室书面许可, 不得部份复制本证书。本证书分离使用无效。

This certificate shall not be reproduced except in full, if not allowed by the laboratory. Invalid for separation using.

5. 复印证书/报告未加盖“检定/校准/检测专用章”无效。

Copies of this report without an official stamp test are not valid.

6. 本次校准所依据的技术文件(代号、名称)。

Reference documents for this calibration(code, name).

JJG 539-2016《数字指示秤检定规程》

7. 本次校准所使用的主要计量标准器具。

Main standards of measurement used this calibration.

设备名称

编号

证书号/有效期

计量特性

Name of Equipment

Serial No

Certificate No./Due Date

Metrological Characteristic

砝码组

002312

1803876/2020-02-27

F1级

8. 校准地点、环境条件。

Place and environmental conditions of the calibration.

校准地点: 本中心实验室

Place of calibration:

温度: 22 °C

Temperature:

相对湿度: 55 %RH

Relative Humidity:

9. 被校准仪器限制使用条件:

*表示可能部分/全部超出我司CNAS能力范围。

Limiting condition of the instrument meterage: *Representation beyond capacity.



扫描全能王 创建

校准结果

Result of Calibration

证书编号: HK1912160652
Certificate No.

第 3 页, 共 3 页
Page of

一、外观及工作性能检查: 外观合格, 功能正常

二、示值误差(kg): (Max=30kg d=0.2kg)

标准值	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
1	1.0	0.0	± 1.0	P
2	2.0	0.0	± 1.0	P
5	5.0	0.0	± 1.0	P
10	10.2	0.2	± 1.0	P
20	20.2	0.2	± 1.0	P
30	30.2	0.2	± 1.0	P

三、重复性误差 (kg):

试验载荷	重复性	允许误差	结论 (P/F)
15.0	0.1	≤ 1.0	P

四、偏载误差(kg):

砝码位置如下图		试验载荷	示值	误差	允许误差	结论 (P/F)
1	2	10	10.1	0.1	± 1.0	P
		10	10.2	0.2	± 1.0	P
4	3	10	10.2	0.2	± 1.0	P
		10	10.2	0.2	± 1.0	P

五. 说明(Note):

1. 结论: 所校准项目符合技术要求。

Conclusion: The calibration project comply with the technical requirements.

2. 本次测量结果的扩展不确定度为: $U=10g, k=2$.

Expanded Uncertainty of the Measurement Results: $U=10g, k=2$.

3. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示:

Conform to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

4. 校准周期: 建议校准周期为壹年。

Calibration interval: The Suggest Calibration interval is one year.

(以下空白)
(The below is blank)



扫描全能王 创建