



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■QMS    ■EMS    ■OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 石家庄美奥科技有限公司                                                                               |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生产技术部                                                                                     | 陪同人员 | 刘盼贞 |
| 不符合事实描述：<br><br>现场审核发现，未提供对气泡检测仪上的压力表、游标卡尺进行了检定/校准使用的证据。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求<br><br>不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般<br><br>审核员：[Signature]    审核组长：[Signature]    受审核方代表：[Signature]<br>日期：2021.4.26    日期：2021.4.26    日期：2021.4.26<br><br>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）<br><br>提供了“压力表、游标卡尺校准证书”，“培训记录”，<br>经验证，采取的措施有效。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>审核组长：[Signature]    日期：2021.5.11 |                                                                                           |      |     |



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对压力表、游标卡尺进行检测和校准。

纠正情况:

联系相关单位对压力表、游标卡尺检定和校准。

原因分析:

对生产技术部人员培训欠缺。

纠正措施:

针对此不符合对生产技术部人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成，经验证有效。

受审核方代表:

王亚军

日期:

2021.5.9



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                              |      |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方        | 石家庄美奥科技有限公司                                                                                                                                                                                  |      |     |
| 受审核部门       | 综合部                                                                                                                                                                                          | 陪同人员 | 刘盼贞 |

## 不符合事实描述：

现场审核发现，

- 1) 大量包装用聚氨酯泡沫在厂房内紧贴堆放，高度过高，与墙周围无过道；
- 2) 2个消防栓无水，被货架、货物遮挡。

上述事实不符合：☐ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：  
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款  
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重    ☒ 一般

审核员：徐心宽

审核组长：古洁

受审核方代表：王亚东

日期：2021.4.26

日期：2021.4.26

日期：2021.4.26

## 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

提供“厂房内部消防栓照片”，“培训记录”

经验证，采取的措施有效。

审核组长：古洁

日期：2021.5.11



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

泡沫在厂房内堆放过高 与墙周围无过道。  
消防栓无水被货架挡住。

纠正情况:

泡沫挪走。  
消防栓通水 周围1.5m内无杂物

原因分析:

对综合部人员培训不到位。

纠正措施:

针对此不符合对综合部人员培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施, 经验证有效。

受审核方代表:

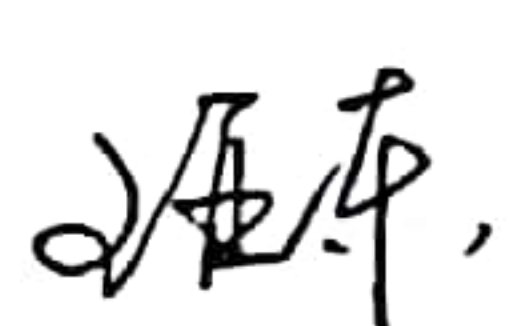
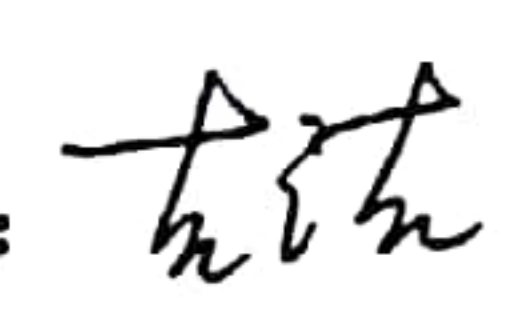
王东

日期:

2021.5.9



不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ■QMS    ■EMS    ■OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段<br>环境管理体系：初次认证第（二）阶段<br>职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |      |     |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 石家庄美奥科技有限公司                                                                               |      |     |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 综合部                                                                                       | 陪同人员 | 刘盼贞 |
| <p>不符合事实描述：</p> <p>现场审核发现，未提供对员工进行了体检的证据。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准    条款<br/><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准    条款：<br/><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准    条款<br/><input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.1.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/>严重    <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员：    审核组长：    受审核方代表：<br/>日 期：2021.4.26    日 期：2021.4.26    日 期：2021.4.26</p> |                                                                                           |      |     |
| <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>提供了“体检表”，“培训记录”<br/>经验证，采取的措施有效。</p> <p>审核组长：    日期：2021.5.11</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |      |     |



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求对员工进行体检.

纠正情况:

组织员工进行体检

原因分析:

对综合部人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对综合部人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题.

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已实施,经验证有效.

受审核方代表:

王金东

日期:

2021.5.9





# 石家庄市藁城中西医结合医院体检表

2021 年 5 月 8 日

|      |                     |   |            |    |    |     |                 |
|------|---------------------|---|------------|----|----|-----|-----------------|
| 姓 名  | 杨丽芳                 |   | 性别         | 女  | 年龄 | 49岁 | 像<br>片          |
| 工作单位 | 石家庄美奥科技有限公司         |   |            |    |    |     |                 |
| 籍 贯  | 河北省藁城市梅花镇连城村振兴街南71号 |   |            |    |    |     |                 |
| 病 史  | 个人史                 |   |            |    |    |     |                 |
|      | 家庭史                 |   |            |    |    |     |                 |
| 五官科  | 视力                  | 左 |            | 鼻  |    |     |                 |
|      |                     | 右 |            |    |    |     |                 |
|      | 眼疾                  | 左 |            | 咽喉 |    |     |                 |
|      |                     | 右 |            |    |    |     |                 |
|      | 听力                  | 左 | 正常         | 齿  |    |     |                 |
|      |                     | 右 | 正常         |    |    |     |                 |
|      | 耳疾                  | 左 |            | 其它 |    |     |                 |
|      |                     | 右 |            |    |    |     |                 |
| 内科   | 血 压                 |   | 125/85 KPa |    |    |     |                 |
|      | 心 脏<br>及<br>血 管     |   | 正常         |    |    |     |                 |
|      | 肺 部                 |   | 正常         |    |    |     |                 |
|      | 腹 部                 |   | 正常         |    |    |     |                 |
|      | 神 经<br>系 统          |   | 正常         |    |    |     |                 |
|      |                     |   |            |    |    |     | 马少民<br>医生<br>签字 |
|      |                     |   |            |    |    |     | 解伟<br>医生<br>签字  |



扫描全能王 创建

|                     |                        |       |    |  |          |
|---------------------|------------------------|-------|----|--|----------|
| 外科                  | 身高                     | Cm    | 体重 |  | 医生<br>签字 |
|                     | 背柱                     |       | 四肢 |  |          |
|                     | 皮肤                     |       | 淋巴 |  |          |
|                     | 泌尿<br>生殖               |       | 其它 |  |          |
| 妇科                  |                        |       |    |  | 签字       |
| 辅助<br>检查            | 化<br>验                 | 肝功+澳抗 |    |  |          |
|                     |                        | 血 脂   |    |  |          |
|                     |                        | 血 糖   |    |  |          |
|                     | 超<br>声<br>波            | 肝 胆   |    |  |          |
|                     |                        | 脾 肾   |    |  |          |
|                     |                        | 胰 腺   |    |  |          |
|                     |                        | 心 脏   |    |  |          |
|                     | 心电<br><br>脑电<br><br>CT |       |    |  |          |
|                     |                        |       |    |  |          |
|                     |                        |       |    |  |          |
| 其它检查                | 胸片：心肺膈未见异常             |       |    |  |          |
| 检查结果及意见             |                        |       |    |  |          |
| 所有体检项目未见异常。         |                        |       |    |  |          |
| 医师 <u>吴永红</u> (诊断章) |                        |       |    |  |          |



# 石家庄市藁城中西医结合医院体检表

2021 年 5 月 8 日

|             |                 |            |    |    |    |          |                |
|-------------|-----------------|------------|----|----|----|----------|----------------|
| 姓 名         | 刘明贞             |            | 性别 | 女  | 年龄 | 29岁      | 像<br>片         |
| 工作单位        | 石家庄美奥科技有限公司     |            |    |    |    |          |                |
| 籍 贯         | 河北省石家庄市桥西区金城街2号 |            |    |    |    |          |                |
| 病 史         | 个人史             |            |    |    |    |          |                |
|             | 家庭史             |            |    |    |    |          |                |
| 五<br>官<br>科 | 视力              | 左          |    | 鼻  |    |          | 沙氏<br>医生<br>签字 |
|             |                 | 右          |    |    |    |          |                |
|             | 眼疾              | 左          |    | 咽喉 |    |          |                |
|             |                 | 右          |    |    |    |          |                |
|             | 听力              | 左          | 正常 | 齿  |    |          |                |
|             |                 | 右          | 正常 |    |    |          |                |
|             | 耳疾              | 左          |    | 其它 |    |          |                |
|             |                 | 右          |    |    |    |          |                |
| 内<br>科      | 血 压             | 120/80 KPa |    |    |    | 医生<br>签字 |                |
|             | 心 脏<br>及<br>血 管 | 正常         |    |    |    |          |                |
|             | 肺 部             | 正常         |    |    |    |          |                |
|             | 腹 部             | 正常         |    |    |    |          |                |
|             | 神 经<br>系 统      | 正常         |    |    |    |          |                |



扫描全能王 创建

|                                                                                                                                                               |             |       |    |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----|--|----------|
| 外科                                                                                                                                                            | 身高          | Cm    | 体重 |  | 医生<br>签字 |
|                                                                                                                                                               | 背柱          |       | 四肢 |  |          |
|                                                                                                                                                               | 皮肤          |       | 淋巴 |  |          |
|                                                                                                                                                               | 泌尿<br>生殖    |       | 其它 |  |          |
| 妇科                                                                                                                                                            |             |       |    |  | 签字       |
| 辅助<br>检查                                                                                                                                                      | 化<br>验      | 肝功+澳抗 |    |  |          |
|                                                                                                                                                               |             | 血 脂   |    |  |          |
|                                                                                                                                                               |             | 血 糖   |    |  |          |
|                                                                                                                                                               | 超<br>声<br>波 | 肝 胆   |    |  |          |
|                                                                                                                                                               |             | 脾 肾   |    |  |          |
|                                                                                                                                                               |             | 胰 腺   |    |  |          |
|                                                                                                                                                               |             | 心 脏   |    |  |          |
|                                                                                                                                                               | 心电          |       |    |  |          |
|                                                                                                                                                               | 脑电          |       |    |  |          |
|                                                                                                                                                               | CT          |       |    |  |          |
| 其它检查                                                                                                                                                          | 胸片：心肺膈未见异常  |       |    |  |          |
| 检查结果及意见<br><br>所有体检项目未见异常<br><br><div style="text-align: right;">  </div> |             |       |    |  |          |

医师

(诊断章)



扫描全能王 创建



# 瑞临计量检测有限公司

RUILIN MENASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

## 校准证书

Calibration Certificate



证书编号: **RLJL2105072001**

CertificateNo.

客户名称

石家庄美奥科技有限公司

Name of Applicant

客户地址

石家庄经济技术开发区创业路20号

Address

器具名称

游标卡尺

Description

型号/规格

(0~150) mm

Model/Type

出厂编号

J043120

Serial No.

制造单位

中国桂林

Manufacturer

批准人

Approved by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by



接收日期:

2021

年

05

月

07

日

Date for Received

Year

Month

Day

校准日期:

2021

年

05

月

07

日

Date for Calibration

Year

Month

Day

批准日期:

2021

年

05

月

07

日

Date for approval

Year

Month

Day

地址(Add.):

河北省石家庄市新华区赵陵北路15号都市阳光小区底商1-6号

电话(Tel):

0311-89230010(收样室)

邮编(Post Code):

050000

网址(Web):

[www.rljljc.com](http://www.rljljc.com)

邮箱(E-mail):

[hbrljlc@163.com](mailto:hbrljlc@163.com)

第1页共3页



# 瑞临计量检测有限公司

RUILIN MENASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: **RLJL2105072001**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                          |              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1、校准地点 (place of the calibration): 本公司长度室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                          |              |            |              |
| 2、校准时的环境条件 (Environmental condition of the calibration):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                          |              |            |              |
| 温度 (Temperature): 20.6℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 相对湿度 (Rel.Humidity): 47% |              | 其他: /      |              |
| 3、所依据/参照技术文件 (代号、名称) Reference documents for the test (Code、Name):<br>JJG30-2012 通用卡尺检定规程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                          |              |            |              |
| 4、本次校准所使用的主要测量标准器具 (Main measurement standards used in the calibration.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                          |              |            |              |
| 测量标准名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 测量范围              | 不确定度/准确度等级/<br>最大允许误差    | 证书编号         | 有效期至       | 溯源机构名称       |
| 量块                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (10~291.8) mm 12块 | 准予作4等使用                  | JXJD20-00188 | 2021.06.08 | 河北省计量监督检测研究院 |
| 5、重要声明 (Important Statement):<br>a、证书未经本机构书面授权, 不得部分复制此证书。<br>The certificates can not be partly copied without approval of the institute.<br>b、本实验室质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求, 并经中国合格评定国家认可委员会认可, 认可证书注册号: CNAS L9333<br>The quality management system of this laboratory meets the requirements of ISO/IEC17025, and approved by China National Accreditation Service for Conformity Assessment, the certificate number is CNAS L9333.<br>c、被校计量器具修理后, 应立即重新校准。<br>Immediate recalibration is essential for the calibrated measuring instrument after its repair.<br>d、在使用过程中如对被校准计量器具的技术参数产生怀疑, 请重新校准。<br>Please calibrate again if the technical index of the calibrated measuring instrument is doubted in use. |                   |                          |              |            |              |
| 6、根据客户要求或校准文件规定, 该器具正常使用情况下建议12个月校准一次, 客户也可根据使用情况, 自行调整校准周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                          |              |            |              |
| 7、备注 (Comments): /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                          |              |            |              |

1. 我公司仅对加盖“瑞临计量检测有限公司校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效, 仅对该器具在校准时的状态负责。



瑞临计量检测有限公司

RUILIN MENASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

# 校准证书

Calibration Certificate


证书编号：RLJL2105072001

## 校准结果

Result of Calibration

| 项目                                   | 标称值/mm | 示值误差/mm |
|--------------------------------------|--------|---------|
| 示值误差                                 | 41.2   | 0.00    |
|                                      | 81.5   | 0.00    |
|                                      | 121.8  | 0.00    |
| 测量结果的不确定度： $U=0.02\text{mm}$ ， $k=2$ |        |         |

——以下空白——



1. 我公司仅对加盖“瑞临计量检测有限公司校准专用章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效, 仅对该器具在校准时的状态负责。



# 瑞临计量检测有限公司

RUILIN MEASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

## 校准证书

Calibration Certificate



证书编号: **RLJL2105072002**

CertificateNo.

客户名称

石家庄美奥科技有限公司

Name of Applicant

客户地址

石家庄经济技术开发区创业路20号

Address

器具名称

精密压力表

Description

型号/规格

(0~0.4)

Model/Type

出厂编号

HC65553083695

Serial No.

制造单位

中国红旗仪表有限公司

Manufacturer

批准人

Approved by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by



接收日期:

2021

年

05

月

07

日

Date for Received

Year

Month

Day

校准日期:

2021

年

05

月

07

日

Date for Calibration

Year

Month

Day

批准日期:

2021

年

05

月

07

日

Date for approval

Year

Month

Day

地址 (Add.):

河北省石家庄市新华区赵陵北路15号都市阳光小区底商1-6号

电话 (Tel):

0311-89230010 (收样室)

邮编 (Post Code):

050000

网址 (Web):

[www.rljlg.com](http://www.rljlg.com)

邮箱 (E-mail):

[hbrljlg@163.com](mailto:hbrljlg@163.com)

第 1 页 共 3 页



# 瑞临计量检测有限公司

RUILIN MENASUREMENT AND DETECTION Co.,Ltd

## 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: **RLJL2105072002**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |                |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------|
| 1、校准地点 (place of the calibration): 本公司力学室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                |            |              |
| 2、校准时的环境条件 (Environmental condition of the calibration):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                |            |              |
| 温度 (Temperature): 21.8℃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 相对湿度 (Rel.Humidity): 42% |                | 其他: /      |              |
| 3、所依据/参照技术文件 (代号、名称) Reference documents for the test (Code、Name):<br>JJG49-2013 弹簧元件式精密压力表和真空表检定规程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          |                |            |              |
| 4、本次校准所使用的主要测量标准器具 (Main measurement standards used in the calibration.):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                          |                |            |              |
| 测量标准名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 测量范围       | 不确定度/准确度等级/<br>最大允许误差    | 证书编号           | 有效期至       | 溯源机构名称       |
| 数字压力表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (0~600)kPa | $U_{rel}=0.025\% (k=2)$  | JXYB20-JZ00595 | 2021.11.10 | 河北省计量监督检测研究院 |
| 5、重要声明 (Important Statement):<br>a、证书未经本机构书面授权, 不得部分复制此证书。<br>The certificates can not be partly copied without approval of the institute.<br>b、本实验室质量管理体系符合ISO/IEC17025标准的要求, 并经中国合格评定国家认可委员会认可, 认可证书注册号: CNAS L9333<br>The quality management system of this laboratory meets the requirements of ISO/IEC17025, and approved by China National Accreditation Service for Conformity Assessment, the certificate number is CNAS L9333.<br>c、被校计量器具修理后, 应立即重新校准。<br>Immediate recalibration is essential for the calibrated measuring instrument after its repair.<br>d、在使用过程中如对被校准计量器具的技术参数产生怀疑, 请重新校准。<br>Please calibrate again if the technical index of the calibrated measuring instrument is doubted in use. |            |                          |                |            |              |
| 6、根据客户要求或校准文件规定, 该器具正常使用情况下建议12个月校准一次, 客户也可根据使用情况, 自行调整校准周期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                          |                |            |              |
| 7、备注 (Comments): /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |                |            |              |

1. 我公司仅对加盖“瑞临计量检测有限公司校准专用章”的完整证书负责。

2. 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效, 仅对该器具在校准时的状态负责。





# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号：RLJL2105072002

## 校准结果

Result of Calibration

| 校准点 (MPa) | 升压 (MPa) | 降压 (MPa) | 示值误差 (MPa) | 不确定度              |
|-----------|----------|----------|------------|-------------------|
| 0.00      | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000     | $U=0.15\%FS, k=2$ |
| 0.04      | 0.0400   | 0.0400   | 0.0000     |                   |
| 0.08      | 0.0800   | 0.0800   | 0.0000     |                   |
| 0.12      | 0.1200   | 0.1200   | 0.0000     |                   |
| 0.16      | 0.1606   | 0.1606   | 0.0006     |                   |
| 0.20      | 0.2004   | 0.2004   | 0.0004     |                   |
| 0.24      | 0.2400   | 0.2400   | 0.0000     |                   |
| 0.28      | 0.2806   | 0.2806   | 0.0006     |                   |
| 0.32      | 0.3208   | 0.3208   | 0.0008     |                   |
| 0.36      | 0.3604   | 0.3604   | 0.0004     |                   |
| 0.40      | 0.4000   | 0.4000   | 0.0000     |                   |

——以下空白——



1. 我公司仅对加盖“瑞临计量检测有限公司校准专用章”的完整证书负责。  
2. 本证书的校准结果仅对所校准的计量器具有效, 仅对该器具在校准时的状态负责。

## 培 训 记 录

|                            |                                                                                                                                                  |     |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 时 间                        | 2021.4.27                                                                                                                                        | 地 点 | 办公室 |
| 主 讲                        | 田艳芳                                                                                                                                              |     |     |
| 参加人员                       | 公司全体人员                                                                                                                                           |     |     |
| 培<br>训<br>主<br>要<br>内<br>容 | <p>1、GB/T 19001-2016 标准的 7.1.5、GB/T24001-2016 标准的 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准的 8.1/9.1.1 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p> |     |     |
| 考<br>核<br>评<br>价<br>情<br>况 | <p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人： 田艳芳</p> <p>2021 年 4 月 27 日</p>                                                                |     |     |