



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-20 不符合报告(03版)

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 二阶段审核 ☐ 初次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	北京胜时代生物科技有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	李新春
不符合事实描述: 查综合部现场, 未提供供方“北京生科宇晟科技有限公司”的“PCR仪、单道可调式移液器、96孔板离心机”的相关合格证明 上述事实不符合: ☒ ISO9001:2015 条款 8.4.3 ☐ GB/T45001-2020 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 李京田 审核组长: 李京田 受审核方代表: 李新春 日期: 2021.6.28 日期: 2021.6.28 日期: 2021.6.28			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 针对不符合制定了纠正和预防措施. 提供了整改证据. 不符合整改有效. 予以关闭 审核员: 李京田 日期: 2021.6.28			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-20 不符合报告(03 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供供方“北京生科宇晟科技有限公司”的“qbit 定量、PCR 仪、单道可调式移液器、96 孔板离心机”等的相关合格证明

纠正情况:

对不符合项已纠正

原因分析:

由于办公室工作人员对 ISO9001:2015 标准 8.4.3 条款学习不到位、理解不透彻

纠正措施:

- 1、对 ISO9001:2015 标准 8.4.3 条款进行培训
- 2、提供 qbit 定量、PCR 仪、单道可调式移液器、96 孔板离心机等的相关合格证明

预定完成日期: 2021.6.29

举一反三检查情况:

立即提供 qbit 定量、PCR 仪、单道可调式移液器、96 孔板离心机等的相关合格证明的材料

受审核方纠正措施有效性的验证:

对 ISO9001:2015 标准 8.4.3 条款理解更加深刻,以后公司供应商提供产品外还会提供相关合格证明

验证人:

李新春

日期:

2021.6.29

受审核方代表: 李新春

日期: 2021.6.29



进货检验记录

SSD—JL—023

[illegible]

体系标准培训记录

SSD-JL-7.2-03

时间：2021 年 6 月 29 日	培训题目：	主办单位：	培训教师：管代
地点：会议室	标准培训	办公室	培训方式：面授
参加培训人员：李新春 凡君 办公室两名员工签字			
培训内容： ISO9001:2015 标准 8.4.3 条款			
考核方式及成绩： 回答提问：办公室员工能够流利、正确回答关于 ISO9001:2015 标准 8.4.3 条款的内容及应用方面内容。			
培训效果评价： 办公室员工对 ISO9001:2015 标准 8.4.3 条款理解深刻，培训措施实施有效，能有效防止类似的不合格再发生			
评价人：周强			

编制：周强 日期：2021 年 6 月 29 日 批准：李新春 日期：2021 年 6 月 29 日



Compact appearance

外观精致



Smooth shock

运行平稳



Security

安全性强



Patent Application

专利产品




4-layer packaging

安全运输

PR-96E 梯度PCR仪

操作说明书

Operating Manual

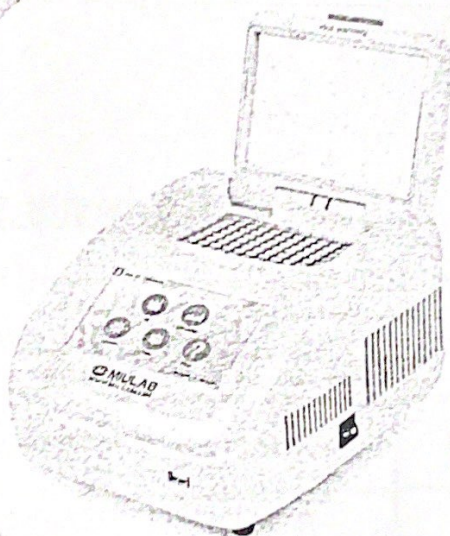

文件由「快扫描」创建

杭州米欧仪器有限公司

Hangzhou Miu Instruments Co., Ltd

附件B PR-96E 梯度PCR仪装箱清单

序号	项目名称	型号规格	单位	数量	备注
1	梯度PCR仪	PR-96E	台	1	
2	电源线		条	1	
3	触摸笔		支	1	
4	产品性能检测表		份	1	
5	操作手册		份	1	
6	保修证		份	1	
应当: (签字/盖章)			装箱日期:		

2020.02.27

附件C PR-96E 梯度PCR仪性能检测表

名 称		梯度PCR仪	型 号	PR-96E	
检测日期		2020.7.27	仪器编号	MU-C155-0053	
序 号	项目名称	检测方法	标准要求	检测结果	
1	基本功能	目测	有效	☐合格	
2	外观要求	目测	符合	☐合格	
3	外观标识	目测	符合	☐合格	
4	连续运行实验	实验操作	72小时无故障	☐合格	
检测结果		合格			
检测人员:		张开庆		确认:	

文件由「快扫描」创建

附件D PR-96E 梯度PCR仪保修证

产品名称	梯度PCR仪
产品型号	PR-96E
出厂编号	MU-C155-0053
购买日期	2020年02月27号
顾客单位	
顾客姓名	
顾客地址	
顾客电话	
顾客传真	
邮 编	
E-mail	

保修说明

本仪器自交货之日起1个月内,对因材料和制造方面的缺陷引起的故障,本公司将负责包换。

本仪器自交货之日起12个月内,对因材料和制造方面的缺陷引起的故障提供免费保修。在保修期内,本公司将对被证明是有缺陷的仪器有选择地进行免费修理或更换。

保修范围

因用户使用不当、在不符合要求的条件下使用、未经授权擅自维修或改装而引起的损坏等,不属于保修范围。(保修期外修理,适当收取成本费。)

维修记录

维修日期	维修记录	经办人

L4-5K
台式低速离心机

使用说明书 (V1.0)

使用前敬请仔细阅读本手册

文件由「快扫描」创建

