



检定证书

证书编号: 霸化字第 2021SY0090 号

送 检 单 位	廊坊京盛食品有限公司
计 量 器 具 名 称	电热恒温培养箱
型 号 / 规 格	DHP-360A
出 厂 编 号	T2019115716
制 造 单 位	天津天泰仪器有限公司
检 定 依 据	JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度校准规范
检 定 结 论	合格

(检定专用章)

批准人

许冬岳

核验员

贾宝越

检定员

刘黎明

检定日期 2021 年 07 月 12 日

有效期至 2022 年 07 月 11 日

霸州市质量技术监督检验所



证书编号: <<报告编号>>

1. 本次检定所用计量标准:

计量标准证书编号:	[2019]廊量标霸州法证字第 015 号	有效期	2023-11-05
使用的计量标准:	环境试验设备温度、湿度校准装置		
溯源性(发证机构):	本次检定所用的计量标准均可溯源至国家基准		

2 检定所用的计量标准器:

名称	规格/型号	出厂编号	不确定度、准确度或最大允许误差	证书编号	有效期
温湿场测量记录仪	HR2016	20140068	$U=0.07^{\circ}\text{C}$ $K=2$	RNFZ20-JZ01368	2021-11-30

3. 检定地点、环境条件:

地点:	现场			
温度:	25℃	相对湿度:	45%	其它: /

4.

限制使用条件和测量范围: /

- 注: 1、未经本所书面授权, 不得部分复印本证书。
2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。
3、本证书未加盖检定专用章无效。



证书编号: <<报告编号>>

5 检定结果/说明:

1、校准结果的表达

设定温度: 36℃ 温度偏差: 0.4℃
温度波动度: +0.3℃ 温度均匀度: 0.3℃

2、测试点分布示意图 (图 B1)

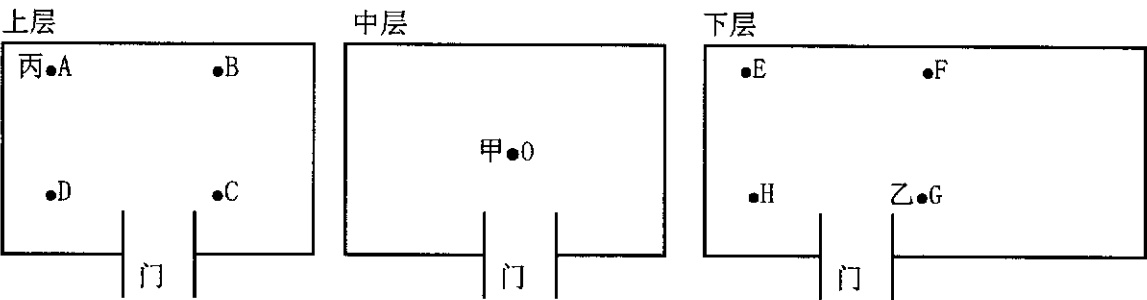


图 B1

3、测试点与壁距离 (mm)

前	后	左	右	上	下
100	100	100	100	300	300

4、校准结果不确定度: $U=0.07^{\circ}\text{C}$ $k=2$

以下空白

注: 1、未经本所书面授权, 不得部分复印本证书。
2、本证书的检定结果仅对所检仪器有效。
3、本证书未加盖检定专用章无效。